

AIRFLOW®

PROPHYLAXIS MASTER

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Содержание →



1. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	2
1.1. НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА.....	3
1.2. СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ	3
1.3. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ.....	4
1.4. КАТЕГОРИЯ ПАЦИЕНТОВ.....	4
1.5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ	5
1.6. СОВМЕСТИМОСТЬ.....	5
1.7. Общие меры предосторожности.....	6
2. УСТАНОВКА	7
2.1. Оборудование, входящее в комплект	7
2.2. Пошаговая установка.....	9
2.3. Ёмкости для порошка	13
2.4. Подача воды и ёмкость для жидкости PIEZON®	14
2.5. Наконечники AIRFLOW® и PERIOFLOW®	15
2.6. Наконечник и инструменты PIEZON®	16
3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТА	17
3.1. Интерфейсы	17
3.2. Цикл процедуры	21
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	22
4.1. Насадки PERIOFLOW®	22
4.2. Эндочак и PI-инструмент	22
4.3. Аспирационная трубка с зеркалом	23
5. ОЧИСТКА И ОБРАБОТКА.....	24
5.1. Очистка и дезинфекция водной линии.....	24
5.2. Информация о безопасном использовании NIGHT CLEANER	26
6. ОБСЛУЖИВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	36
6.1. ЗАКУПКА НАКОНЕЧНИКА AIRFLOW® ПОРОШКОМ	36
6.2. Течь в наконечнике AIRFLOW®	36
6.3. Световод PIEZON®: ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА	36
6.4. Замена шнура наконечника.....	37
6.5. Ежемесячные проверки	37
6.6. Ежегодное обслуживание и ремонт	38
6.7. Подключение новой педали.....	38
6.8. Поиск и устранение неполадок.....	39
6.9. Координаты для связи со службой поддержки EMS.....	42
6.10. Для сообщения о неблагоприятном событии необходимо	42
7. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	43
7.1. Утилизация использованных частей	43
7.2. Экологичная конструкция	43
8. ГАРАНТИЯ	43
9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ	44
9.1. Символы	45
9.2. Электромагнитная совместимость	46
9.3. Соответствие радиооборудования	48
10. АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ	49

1. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Теперь вы являетесь собственником нового аппарата компании EMS!

Внимательно прочтите инструкцию перед его использованием →



ВО ИЗБЕЖАНИЕ получения травмы от поражения электрическим током это оборудование следует подключать только к электросети с защитным заземлением. Данное устройство использует изоляционную систему I-класса, требующую наличия защитного заземления.

для США и КАНАДЫ: НАДЕЖНОСТЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ МОЖЕТ ДОСТИГАТЬСЯ, ТОЛЬКО ЕСЛИ ОБОРУДОВАНИЕ ПОДКЛЮЧЕНО К ЭВИВАЛЕНТНОМУ РАЗЪЕМУ, С УКАЗАНИЕМ "ТОЛЬКО ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ" ИЛИ "ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ".



НЕ вносите изменения в это оборудование и/или его вспомогательные элементы.

Любые изменения любых частей данного медицинского устройства запрещены.



НЕ вскрывайте данное устройство. Внутри него отсутствуют элементы, подлежащие обслуживанию.



При возникновении любого серьезного инцидента, прямо или косвенно связанного с этим устройством, незамедлительно сообщите о нем производителю и компетентному органу в вашей стране и в стране размещения пациента (если различаются).



Выньте шнур питания от электросети из розетки при проведении техобслуживания, в случае возникновения неисправности или при оставлении устройства без присмотра.



Отключайте водоприемник, если он не используется. Устройство не оснащено аквастоп-элементом, и водный шланг EG-110 может отсоединяться или протекать - риск затапливания.



Инструкции по эксплуатации устройства и Рекомендации по проведению процедур (FB-648) и PIEZON® Рекомендации по проведению процедур (FB-652) предоставляются в электронном формате и являются частью документации по аппарату. Тем не менее, если вы хотите получить их копию на бумажном носителе, вы можете запросить один бесплатный экземпляр на нашем сайте, по телефону, или написав письмо, и получить его в течение 7 дней.

- Инструкции по эксплуатации устройства (FB-618) и Рекомендации по проведению процедур (FB-648) и PIEZON® Рекомендации по проведению процедур (FB-652) доступны для загрузки в формате PDF на сайте www.ems-instruction.com с помощью кода продукта/ключа FT-229. Вам потребуется программа, работающая с PDF-файлами. При необходимости вы можете загрузить её с того же сайта.
- Важно сначала прочитать и понять все инструкции по эксплуатации и только затем приступить к работе с устройством и соответствующими вспомогательными элементами. Рекомендации по проведению процедуры являются составляющей частью инструкции по эксплуатации. Каждый из этих документов дополняет другой. Данные документы должны быть у вас всегда под рукой.
- Мы рекомендуем вам регулярно посещать наш сайт для ознакомления с последней версией документов по вашему устройству и их загрузки на сайте www.ems-instruction.com
- Свяжитесь со службой технической поддержки EMS или вашим локальным представителем EMS для получения более подробной информации и поддержки.

1.1. Назначение устройства

Данное устройство совмещает в себе следующие технологии:

- PIEZON®: ультразвуковой скалер
- AIRFLOW®: технология воздушной полировки

Предназначено для использования в целях

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОСТИ РТА

при проведении профилактики для удаления биопленки и зубного камня с натуральных зубов, пломб и имплантатов

1.2. Сфера применения

Нанесение на натуральные зубы, включая гладкие поверхности, выемки, щели, межзубные пространства, зубные пломбы и имплантаты.

Показания к применению AIRFLOW®:

- удаление налета для размещения герметиков;
- подготовка поверхности перед использованием бондинга/цементации вкладок, накладок, коронок и виниров;
- подготовка поверхности перед использованием композитной пломбировки;
- эффективное удаление налета и пигментных пятен у пациентов ортодонтического профиля;
- чистка перед бондингом ортодонтических брекетов;
- чистка крепления имплантата перед установкой;
- удаление пигментных пятен для определения цвета;
- удаление налета перед фторированием;
- удаление налета и пигментных пятен перед отбеливанием.

Показания к применению PERIOFLOW®:

- профилактическая обработка глубоких пародонтальных карманов глубиной до 9 мм после проведения начального лечения;
- удаление биопленки;
- чистка имплантатов.

Показания к применению PIEZON®:

- удаление наддесневого зубного камня;
- удаление поддесневого зубного камня;
- пародонтологическое лечение;
- подготовка апраксимальных полостей;
- пломбировка вкладок и накладок под цвет зубов высокотиксотропными цементами двойного затвердевания;
- эндо-препарирование, очистка и ирригация корневых каналов;
- ретроградное эндо-препарирование корневых каналов;
- эндо-конденсация гуттаперчи;
- эндо-удаление коронок и мостов;
- Ортопедия: подготовка полостей
- Ортопедия: цементация восстановительных элементов
- Ортопедия: конденсация амальгам
- Ортопедия: удаление коронок, мостов, вкладок и штифтов

1.3. Целевая аудитория

Только **квалифицированные стоматологи, зубные гигиенисты и стоматологический персонал** могут использовать данное устройство при полном соблюдении соответствующих норм, действующих в их стране, мер предотвращения несчастных случаев и при строгом соблюдении инструкций по эксплуатации.

- !** Данное устройство может подготавливаться и использоваться только лицами, прошедшими обучение по защите от распространения инфекций, персональной защите и безопасности пациентов.
- Неправильное использование (например, пренебрежение гигиеной и профилактическим обслуживанием устройства), несоблюдение наших инструкций и использование вспомогательных элементов и запасных частей, не утвержденных EMS, делает недействительными все претензии по гарантии и любые иные претензии.*

Для использования данного медицинского устройства не требуется какое-либо иное обучение, кроме начального профессионального.

Лицо, использующее устройство, несет ответственность за выполнение клинических процедур и за любые риски, которые могут возникнуть ввиду недостатка навыков и/или обучения.

Для обеспечения оптимального комфорта пациента, безопасности и эффективности мы предлагаем вам регулярно следовать нашей

Программе обучения ШВЕЙЦАРСКОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ



Вы знакомы с Guided Biofilm therapy? Если нет:

ПРОЙДИТЕ ОБУЧЕНИЕ СЕЙЧАС

Для получения дополнительной информации обратитесь к местному представителю компании EMS.



Для обеспечения оптимального начала работы устройства и максимальной надежности мы настоятельно рекомендуем провести профессиональную установку аппарата и его ввод в эксплуатацию в присутствии сертифицированного представителя EMS.

1.4. Категория пациентов

Устройства PIEZON® предназначены для пациентов, которым требуется стоматологическое лечение, включая скейлинг (например, поддесневой или наддесневой зубной камень, пятна), эндодонтия (например, лечение корневого канала), ортопедия (например, полости, амальгамы), пародонтальная и стоматологическая профилактика вне зависимости от возраста и пола пациента.

Устройства AIRFLOW® предназначены для пациентов, которым требуется стоматологическое лечение, включая чистку и полировку зубов (натуральных или имплантатов) струей из смеси воды, воздуха и стоматологических порошков вне зависимости от возраста и пола пациента.

- !** Это медицинское устройство не предназначено для использования для новорожденных (грудных детей) и младенцев (<2 лет).

1.5. Противопоказания

⚠ Противопоказания при лечении:

AIRFLOW® и PERIOFLOW®	противопоказаны для	Пациентов с тяжелыми или нестабильными инфекциями верхних дыхательных путей, хроническим бронхитом/астмой ¹ .	PIEZON®
PERIOFLOW®	противопоказан для	Беременных и кормящих грудью пациенток	AIRFLOW® и PIEZON® PS
PERIOFLOW®	противопоказан для	Пациентов с серьезным воспалением или/и остеонекрозом.	AIRFLOW® PLUS и PIEZON® PS
PIEZON®	противопоказан для	Пациентов с кардиостимулятором, дефибрилляторами и вживленным электронным устройством.	AIRFLOW® PLUS

Возможные альтернативы:

⚠ Решение использовать AIRFLOW® и/или PERIOFLOW® для пациентов с контагиозными заболеваниями или риском инфекций должно приниматься стоматологом/врачом на индивидуальной основе в соответствии с уровнем защиты врача, оценкой риска пациента и применимыми национальными нормами.

⚠ Для пациентов, проходящих бисфосфонат-терапию, решение об использовании AIRFLOW® и/или PERIOFLOW® должно приниматься стоматологом/врачом на основании состояния здоровья полости рта пациента.

⚠ Противопоказания по порошку AIRFLOW®:

Порошок CLASSIC	противопоказан для	Пациентов, соблюдающих диету с низким содержанием соли.	AIRFLOW® PLUS
Ароматизированный порошок CLASSIC	противопоказан для	Пациентов с вкусовой и ароматической аллергией.	AIRFLOW® PLUS/PERIO и CLASSIC NEUTRAL
Порошок PLUS	противопоказан для	Пациентов с аллергией на хлоргексидин.	AIRFLOW® PERIO
Порошок PERIO и SOFT	противопоказан для	Пациентов с аллергией на глицин (гликоколь).	AIRFLOW® PLUS

Возможные альтернативы:

1.6. Совместимость

Данное устройство совместимо со следующими вспомогательными элементами:

Порошки AIRFLOW®	Порошки PLUS: серии DV-082, DV-086 Порошки CLASSIC: серии DV-048 Порошки PERIO и SOFT: серии DV-070, DV-071
Наконечник AIRFLOW®	EL-308
Наконечник PERIOFLOW®	EL-354
Наконечники PIEZON®	EN-060, EN-061
Инструменты для скейлинга и периодонтальные инструменты PIEZON®	PS, A, B, C, P, PL1, PL2, PL3, PL4, PL5, HPL3, DPL3, PI
Инструменты эндодонтии PIEZON®	RT1, RT2, D, H, ESI, эндо-файлы ISO 15, 20, 25, 30, 35, эндочак 180°, 120° и 90°, RT3, RE2, BERUTTI
Инструменты консервативного лечения PIEZON®	E, F, G, SP
Инструменты подготовки полостей PIEZON®	SM, PF, SD, VE, SB, SBD, SBM

¹ Связано с возможным вдыханием порошка при лечении устройством AIRFLOW®.

Рабочие части

Следующие элементы являются рабочими частями медицинского устройства:

- Наконечник AIRFLOW® (EL-308)
- Наконечник PERIOFLOW® (EL-354)
- Наконечники PIEZON® (EN-060 и EN-061)

⚠️ Температура рабочих частей в приопределённых условиях использования может превышать 41°C и достигать максимальной температуры 51°C.

1.7. Общие меры предосторожности



ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ КОМПАНИИ EMS!

⚠️ Использование любых других вспомогательных элементов может привести к травмированию пациента, неисправности или повреждению оборудования

⚠️ НЕ используйте данное устройство в присутствии горючих анестетиков или окисляющих газов (таких как оксид азота (N₂O) и кислород) или вблизи летучих растворителей (таких как эфир или спирт) ввиду риска взрыва.

⚠️ НЕ храните порошок рядом с кислотами или источниками тепла.

⚠️ ПРИМЕНЯЙТЕ следующие меры предосторожности во избежание неблагоприятных последствий для пациента и/или пользователя в случае возникновения электромагнитных помех:

- Всегда помните об указаниях, перечисленных в разделе “Электромагнитная совместимость”.
- При неисправности беспроводной педали, предположительно вызванной электромагнитными помехами, используйте педаль с проводным подключением.
- При неисправности устройства, предположительно вызванной электромагнитными помехами, сначала проверьте кабельное подключение, затем максимально отдалите радиочастотное коммуникационное оборудование и мобильные устройства, находящиеся рядом, для исключения помех.
- Прекратите использование устройства, если электромагнитные помехи сохраняются, и свяжитесь с технической поддержкой EMS для получения помощи.

2. УСТАНОВКА

2.1. Оборудование, входящее в комплект

! Проверьте содержимое на наличие любых повреждений, которые могли быть получены при транспортировке.



**Аппарат AIRFLOW
Prophylaxis Master®**

с установленными
основным винтом,
водным и воздушным
фильтрами
FT-229/A



**Краткое
руководство**

со ссылками для
загрузки Инструкции
пользователя eIFU и
регистрацию
аппарата



Кабель питания

Тип штекера зависит от
страны



**Профилактический
порошок
AIRFLOW® PLUS**

12x DV-082



**Ёмкости для
порошка
PLUS: EL-607
CLASSIC: EL-606**



Воздушный шланг
EH-142

Водный шланг
EG-110



**Профилактический
порошок
AIRFLOW®
CLASSIC**

2x DV-048



NIGHT CLEANER
DV-154
(800 мл)



CLIP+CLEAN
2x AB-613
(комплект EL-655)



**Ёмкость для воды
PIEZON®**

EG-111



**Шнур
д/наконечника
AIRFLOW®**
EM-145



Одна из следующих педалей:

**Беспроводная
педаль с Boost
режимом**
EK-404A
с 2 литиевыми батарейками
типа AA 1,5 В



**NIGHT CLEANER
Ёмкость**

EG-120



**Шнур
д/наконечника
PIEZON®**
EM-146



**Педаль с
проводным
подключением**
EK-410

AIRFLOW

SUB & SUPRAGINGIVAL

FS-442 / FS-447 (см. ниже)²



- 1** EL-308: Наконечник AIRFLOW®
- 2** AB-470A/A: Easy Clean
- 3** Трубка Ultra FS ClasenUNO
- 4** EL-651: Прокладки шнура
- 5** EI-600: Водный фильтр
- 6** EL-599: Воздушный фильтр

PIEZON

SUB & SUPRAGINGIVAL

FS-441




- 1** EN-060: Наконечник PIEZON®
- 2** DS-001A: Инструмент A
- 3** DS-016A: Инструмент PS
- 4** DS-011A: Инструмент P
- 5** 4x AB-340: Световод

PERIOFLOW

PERIO & IMPLANT

Дополнительно: FS-443

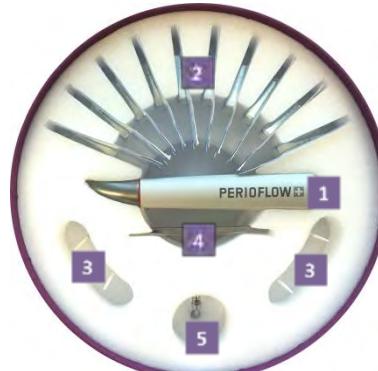

- 1** EL-354: Наконечник PERIOFLOW®
- 2** 10x AB-327A/A: Насадок PERIOFLOW®
- 3** 6x DT-064: PI-инструмент
- 4** DT-018: Плоский ключ (сверху)
- 5** DS-010: Эндочак 120°

² Комплект AIRFLOW® FS-442 содержит трубку ClasenUNO в Европейском союзе. Код для остальных стран - FS-447.

2.2. Пошаговая установка

Найдите подходящее место для размещения аппарата.

! Поместите данный аппарат (блок управления) в стоматологическом кабинете в удобном для вашей работы месте и оставьте достаточно свободного пространства для легкого перемещения и надлежащего проветривания.

! Оставьте зазор в 10 см по всему периметру устройства и не ставьте на него другие приборы.

Он должен быть установлен на устойчивой и ровной поверхности (с максимальным наклоном в 5 градусов).

Проверьте надлежащее состояние линий подачи воды и воздуха.

Убедитесь в том, что в вашем стоматологическом кабинете есть источники фильтрованной воды и сжатого воздуха с подключением воздушных и водных шлангов EG-110 и EH-142 соответственно.

! Если водопровод и воздуховод в вашем кабинете не оснащены необходимыми шлангами EG-110 и EH-142, надлежащая установка может быть обеспечена только квалифицированным персоналом. Позвоните в службу поддержки EMS для получения помощи.

! Во избежание пост контаминации подключите кабель к источникам жидкости, соответствующим EN-1717 или DVGW³.

Убедитесь в наличии подходящей и безопасной электросети.

- !** Данный аппарат использует изоляционную систему I-класса, требующую наличия защитного заземления.
- !** Подключайте аппарат только к сети питания с защитой типа FI (FI = защита от остаточного тока). Для США и Канады: подключайтесь только к розетке класса, предназначенного для больниц.
- !** Убедитесь в том, что номинальное напряжение устройства соответствует локальному сетевому напряжению, чтобы предотвратить повреждение прибора, возникновение пожара и поражения электротоком.
- !** Выключатель прибора от сети должен быть всегда доступен.

! НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ данный аппарат, если ваш стоматологический кабинет НЕ оснащен защитным заземлением. Если у вас есть какие-либо сомнения на этот счет, позвоните в службу поддержки EMS для получения помощи от квалифицированного персонала на месте.

Внимание!

- !** Использование кабелей и вспомогательных принадлежностей, отличных от тех, которые поставляет компания EMS, может отрицательно сказаться на ЭМС. Используйте только детали, поставляемые компанией EMS.
- !** Устройство использует маломощную радиосвязь, макс. 1 дБм ЭИИМ, Bluetooth® 2,4 ГГц для связи с беспроводной педалью. Вблизи данного оборудования могут возникать помехи.

Радиосигнал Bluetooth® автоматически деактивируется (отключается) при подключении педали с проводным соединением.

Портативное оборудование для радиочастотной связи (включая периферийные устройства, такие как антенный кабель или внешние антенны) должно использоваться с пространственным разносом не менее 30 см (12 дюймов) между ним и данным устройством, включая кабели. В противном случае может иметь место ухудшение работы данного оборудования.

³ Немецкая научно-техническая ассоциация газо-и водоснабжения

Подключите воздушные и водные шланги

Переверните устройство вверх ногами и поставьте его в таком положении.

- Подключите воздушный шланг EH-142 к кабинетной/стоматологической установке.

Плотно вставьте разъем шланга в воздушный разъем (он может быть жестким).

Давление: 4,5 – 7 бар
Сухой воздух. Макс. влажность 1,032 г/м³
Фильтрация: макс. 1 мкм

- Подключите водный шланг EG-110 к кабинетной/стоматологической установке.

⚠ Во избежание пост-контаминации подключите кабель к источникам жидкости, соответствующим EN-1717 или DVGW.

🚫 НЕ устанавливайте ёмкость для воды PIEZON® или ёмкость NIGHT CLEANER до подключения воздушной и водной линий.

Питьевая вода
Давление: 2 – 5 бар
Минерализация: макс. 0,2%
Температура: от 10°C до 30°C

Установите аксессуары

Продолжайте удерживать устройство в перевернутом положении и отключенным от сети!



EH-142
1 Воздушный шланг - фильтр уже установлен
НАЖМИТЕ С УСИЛИЕМ

EG-110
2 Водный шланг - фильтр уже установлен

3 Шнур питания в розетке
(патрон предохранителя в розетке)

EK-410
4 Педаль с кабельным подключением
ТОЛЬКО ЕСЛИ ПРИМЕНИМО

EM-145
5 Шнур насадки AIRFLOW® + привод замка
НАЖМИТЕ С УСИЛИЕМ

EM-146
6 Шнур насадки PIEZON® + привод замка
НАЖМИТЕ С УСИЛИЕМ

Проверьте соединения шнура



Шнур наконечника не полностью подключен.



НАЖМИТЕ С УСИЛИЕМ для контакта.


Система правильно подключена и заблокирована.

Для отсоединения системы шнура наконечника одновременно разблокируйте соединение и потяните.

Закрепите устройство

Вы найдете "Основной винт" по центру нижней части устройства.

Сначала отвинтите Основной винт и используйте его для надежного закрепления аппарата на столе или на опоре аппарата AL-125 в вашем кабинете (деталь AL-125 доступна у нашей службы послепродажного обслуживания и у наших дилеров).

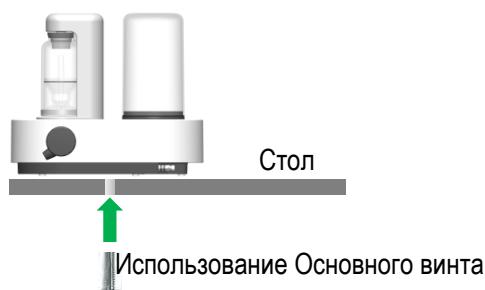

- !
Закрепите ваш аппарат с помощью "Основного винта" для того, чтобы его нельзя было снять без специального инструмента.
- !
Проверьте расположение аппарата, чтобы оно соответствовало вашему полю зрения и характеристикам вашего персонального рабочего места (освещение и расстояние между пользователем и устройством). Аппарат должен всегда оставаться быстро и легко доступным.
- !
Убедитесь в том, что водные и воздушные линии, а также шнур питания не мешают Вашим движениям.

Подключите аппарат к сети питания

Теперь вы можете подключить шнур питания к сети.

⚠️ Обязательно наличие защитного заземления!

Убедитесь в наличии у вашей электрической сети действующего защитного заземления.

Напряжение: 100-240 В АС

Частота: 50 - 60 Гц.

Рабочий ток: макс. 4 А

Установка педали с беспроводным соединением



Вставьте 2 (две) литиевые батареики АА 1,5 В в педаль с беспроводным соединением. Закройте крышку. Устройство готово к работе.

⚠️ Риск возгорания: используйте только батареики, которые имеют токоограничитель/защиту от коротких замыканий и перегрева (в соответствии с IEC 60086-4:2014 Безопасность литиевых батарей).

Беспроводная педаль, прилагаемая к устройству, уже подключена и готова к использованию (примечание: одна педаль может управлять единовременно только одним устройством; подключение сохраняется даже при удалении батареек).

При получении нового прибора все, что от вас требуется, это вставить 2 (две) литиевые батареики АА в беспроводную педаль, и ваше устройство готово к работе.

При замене педали вам необходимо подключить новую педаль к аппарату. Инструкции приведены в разделе "Обслуживание и устранение неисправностей".

Радиосигнал Bluetooth® автоматически деактивируется (отключается) при подключении педали с проводным соединением.

⚠️ Беспроводная педаль использует маломощную радиосвязь, макс. 1 дБм ЭИИМ, Bluetooth® 2,4 Гц для связи с блоком управления. Вблизи данного оборудования могут возникать помехи.

Портативное оборудование для радиочастотной связи (включая периферийные устройства, такие как антенный кабель или внешние антенны) должно использоваться с пространственным разносом не менее 30 см (12 дюймов) между ним и данным устройством, включая кабели. В противном случае может иметь место ухудшение работы данного оборудования.

2.3. Ёмкости для порошка

- ⚠ Клинический риск:** используйте только порошок PLUS или PERIO в ёмкости для порошка PLUS.
- ⚠ Клинический риск:** для удаления поддесневого налета используйте только ёмкость для порошка PLUS (красная).

PLUS



Ёмкость для порошка PLUS предназначена для порошка PLUS. Она может использоваться для над- и поддесневого лечения.

Давление автоматически снижается для соответствия поддесневым процедурам, включая процедуры PERIOFLOW (наддесневые процедуры также возможны). Совместимые порошки EMS: PLUS и PERIO (см. параграф "Совместимость" для получения более подробной информации).

CLASSIC



Ёмкость для порошка CLASSIC предназначена для порошка CLASSIC и может использоваться только для наддесневых процедур.

Бикарбонат натрия: Используйте только эти порошок и ёмкость для наддесневых процедур.

Совместимые порошки EMS: CLASSIC и SOFT (см. параграф "Совместимость" для получения более подробной информации).

! Проверьте целостность ёмкостей для порошка: на корпусе не должно быть трещин.

⚠ При работе аппарата, ёмкость для порошка находится под давлением. Неисправные детали следует немедленно заменить.

! Убедитесь в том, что ёмкости для порошка сухие.

! Используйте только порошки PLUS или PERIO после пломбировки, установки мостов, имплантатов и ортодонтических конструкций.

🚫 Не стерилизуйте ёмкости для порошка и их крышки/детали паром или сухой термообработкой. Используйте только активное дезинфицирующее средство или чистящее средство при температуре окружающей среды.



! Только вручную: снимите крышку ёмкости для порошка и насыпьте порошок до указанного максимального уровня, затем снова плотно закройте ёмкость крышкой.

Насыпайте порошок свободным потоком. Центральная трубка может быть полностью наполнена без проблем

🚫 Не наполняйте ёмкость более, чем до указанного максимального уровня - MAX. Уровень порошка слегка понизится через несколько минут после наполнения (уплотнение порошка).

До начала работы расположите ёмкость для порошка в аппарате. Магнит правильно установит ее.

🚫 Не вставляйте её вверх ногами.

2.4. Подача воды и ёмкость для жидкости PIEZON®

Без ёмкости:

PIEZON® и AIRFLOW® используют внешнюю подачу воды.



⚠ Деталь CLIP+CLEAN перед использованием необходимо очистить и продезинфицировать. Недезинфицированная деталь CLIP+CLEAN может вызвать загрязнение устройства.



! Поместите CLIP+CLEAN в приемник для ёмкости аппарата для защиты от пыли.

С подсоединеной ёмкостью:

AIRFLOW® использует внешнюю подачу воды.

PIEZON® использует подачу жидкости из ёмкости.



Подсоедините ёмкость PIEZON®

⚠ Используйте только ёмкость PIEZON® EG-111 (прозрачная) для дезинфицирующих растворов.

Ёмкость PIEZON® совместима со следующими растворами:

⚠ Избегайте нежелательных химических реакций или проглатывания осадка раствора. Всегда промывайте контур циркуляции жидкости питьевой водой перед использованием другого раствора или проходите регулярную обработку, использующую только воду.

! Для процедуры используйте концентрацию раствора согласно здравому смыслу и местному законодательству и рекомендациям.

Раствор	Концентрация
Натрий гипохлорит	До 5%
Хлоргексидин	До 1%
Карбенилиды	До 0,05%
Повидон-йод	До 12%
Четвертичное соединение аммония	До 0,7%
Цетилпиридinium хлорид	До 1%
Лимонная кислота	До 5%
Физиологический раствор (NaCl %)	До 0,9%
Этиловый спирт	До 5%
Изопропанол	До 5%



🚫 Не стерилизуйте ёмкость PIEZON® и её крышку паром или сухой термообработкой. Используйте только активное дезинфицирующее средство или чистящее средство при температуре окружающей среды.

2.5. Наконечники AIRFLOW® и PERIOFLOW®

⚠ Наконечники AIRFLOW® и PERIOFLOW® могут использоваться повторно, но должны пройти обработку: чистка, дезинфекция и стерилизация. Нестерильные наконечники и аксессуары могут вызвать бактериальные или вирусные инфекции.



Подсоедините
наконечник AIRFLOW® или PERIOFLOW®.

⚠ Следуйте инструкциям “Обработка деталей EMS” и нормам, действующим в вашей стране.

При засорении наконечника AIRFLOW® обратитесь к разделу “Обслуживание и устранение неисправностей” для получения необходимых инструкций.


2.6. Наконечник и инструменты PIEZON®

⚠️ Наконечники и инструменты PIEZON® могут использоваться повторно, но должны пройти обработку: чистка, дезинфекция и стерилизация. Нестерильные наконечники и аксессуары могут вызвать бактериальные или вирусные инфекции..


⚠️ Следуйте инструкциям “Обработка деталей EMS” и нормам, действующим в вашей стране.

⚠️ Проверьте длину инструмента с помощью правой стороны обложки краткого руководства (Quick Guide).

⚠️ Если край инструмента в красной зоне, он может иметь чрезмерные и неконтролируемые вибрации. Замените инструмент.



Аксессуары можно приобрести у компании EMS и сертифицированных дилеров.

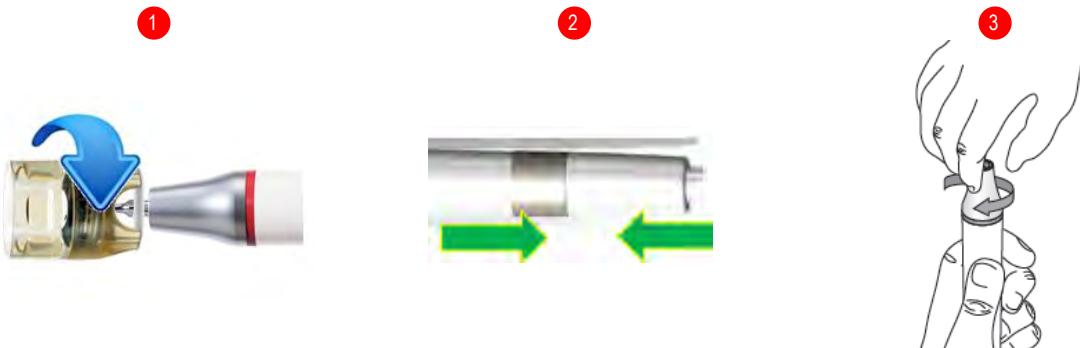

Установите инструмент с помощью ключа EMS CombiTorque

! После полного вкручивания инструмента ключ нужно повернуть еще на четверть оборота, чтобы обеспечить нужное усилие, и снять CombiTorque.

⚠️ Пользуйтесь только CombiTorque для крепления инструмента EMS к наконечнику для обеспечения нужного крутящего момента во избежание отвинчивания и переламывания инструмента.

Подсоедините наконечник PIEZON®

! Продуйте досуха соединения, чтобы удалить возможную жидкость и обеспечить электрический контакт.

Колпачок и световод

! Всегда используйте насадку со световодом и установленным и правильно затянутым носовым колпачком.

Для замены световода обратитесь к разделу “Световод PIEZON®: проверка и замена”.

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТА

3.1. Интерфейсы

УСКОРЕННЫЙ РЕЖИМ BOOST
Нажмите сильно

НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ
Нажмите слегка

Режим ВКЛ/ВЫКЛ-Ожидание

Помещение ёмкости для порошка под давление / снятие давления

Настройка мощности

Вода PIEZON®

Вода AIRFLOW®

Педаль (нормальный режим)

Педаль УСКОРЕННЫЙ РЕЖИМ
(только для беспроводной педали)

ВКЛ: устройство переходит в рабочий режим.
ВЫКЛ: устройство возвращается обратно в режим ожидания.
(через 1 час простоя устройство переключается в выкл-режим ожидания)

Ёмкость для порошка может быть помещена под давление или освобождена от него.
При создании давления включается белая подсветка ёмкости для порошка.
При снятии давления в ёмкости кабель AIRFLOW® автоматически прочистится, и белая подсветка выключится по окончании процесса.

Вход в режим ожидания: Ёмкость для порошка автоматически выводится из-под давления.

! Этот процесс может занять до 10 секунд до полного завершения.
В это время мы рекомендуем вам направлять наконечник AIRFLOW® с его держателем носиком вниз во избежание распыления продувочного воздуха и остаточного порошка вверх.

Поместите палец в паз под цифрами для регулировки давления воздуха AIRFLOW® и мощности PIEZON®:

- 0 (только вода, синий индикатор)
- 10 (максимум)

Запоминание выбранных настроек.

Установите расход воды PIEZON®.

Установите расход воды AIRFLOW®.

Нажмите на край педали для активации нормального режима работы.
Педаль отключается, когда оба шнура наконечников размещаются в держателях.

Сильное нажатие на центр беспроводной педали активирует усиленную подачу энергии.
Для простой активации ускорения оставьте ступню на педали и поднимите пятку.

Настройка питания PIEZON®



Это устройство оснащено технологией NO PAIN®, обеспечивающей адаптивный функциональный отклик в зависимости от нагрузки, приложенной к инструменту.

В следующей таблице указана максимальная выходная мощность в зависимости от настройки этого параметра пользователем:

PIEZON®	Индикатор мощности	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Мощность	Максимальная выходная мощность [Вт]	0	0,4	1,2	2,1	3,0	3,9	4,8	5,6	6,4	7,2	8,0

⚠ Риск перелома инструмента: при использовании ЭНДО файлов не превышайте мощность в 2,5 Вт (макс. настройка мощности "3")

Настройка давления AIRFLOW®



Обе ёмкости для порошка - PLUS и CLASSIC - оснащены встроенным динамическим регулятором давления, который автоматически устанавливает оптимальный диапазон давления для выбранной ёмкости для порошка и соответствующий тип мощности, как указано в разделе “Ёмкости для порошка” (2.3).

В следующей таблице указаны статическое и примерное динамическое давление⁴ в зависимости от выбранной ёмкости для порошка и настройки мощности пользователем:

AIRFLOW®	Настройка давления	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Давление	Статическое [бар]	/	2,5	2,7	3,0	3,2	3,5	3,7	4,0	4,2	4,5	4,7
	Динамическое CLASSIC [бар]	/	1,9	2,1	2,3	2,6	2,8	3,0	3,2	3,5	3,7	3,9
	Динамическое PLUS [бар]	/	1,5	1,7	1,9	2,0	2,2	2,4	2,6	2,7	2,9	3,1

⁴ Динамическое давление также зависит от наконечника и типа порошка. Указанные значения давления приведены для справки и относятся к общеиспользуемой насадке EL-308 AIRFLOW® с порошками DV-082 и DV-048.

УСКОРЕННЫЙ РЕЖИМ PIEZON® и AIRFLOW®



Эффект УСКОРЕННОГО РЕЖИМА

Сильное нажатие на центр беспроводной педали активирует УСКОРЕННЫЙ режим и приводит к повышению мощности, как указано в таблице:

AIRFLOW® Ускоренный режим	Индикатор мощности	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Соответствующий уровень Ускоренного режима	0	6	7	8	8	8	9	10	10	10	10

PIEZON® Ускоренный режим	Индикатор мощности	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Соответствующий уровень Ускоренного режима	0	6	7	8	9	10	10	10	10	10	10

⚠️ Риск перелома инструмента: используйте УСКОРЕННЫЙ РЕЖИМ только с инструментами, подходящими для повышенной мощности.

🚫 НЕ используйте УСКОРЕННЫЙ РЕЖИМ с ЭНДО файлами.

Экономия заряда батарейки беспроводной педали

Каждый раз, когда педаль отпускается, она переходит в режим пониженного потребления энергии. Даже при длительном неиспользовании нет необходимости вынимать батарейки.

Во избежание непреднамеренной разрядки батареек беспроводной педали при непрерывном нажатии педали в течение 10 минут, она автоматически перейдет в режим ВЫКЛ.

Для выхода из этого режима необходимо сначала отпустить педаль, а затем выключить и включить устройство (отключить на 30 с и затем включить снова).

Настройки температуры воды и громкости обратной связи

По умолчанию температура воды AIRFLOW® и PIEZON® равна 40°C.

Для регулировки температуры воды или акустической обратной связи выполните следующие действия:

1. Включите аппарат.
2. Аккуратно поместите оба наконечника (AIRFLOW® и PIEZON®) обратно в их держатели.
3. Одновременно нажмите ⑩ + ⑩ для входа в меню (см. изображение снизу - поместите пальцы в паз под числами).



4. На цифрах появятся цвета:

- 0 - 4: для настройки температуры воды (5 не используется);
- 6 - 10: для настройки акустической обратной связи (5 не используется).



5. Изменяйте данные настройки по своему выбору.
6. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ для сохранения настройки и выхода.

Примечание:

- Изменения применяются к температурам жидкостей и AIRFLOW®, и PIEZON®.
- Через несколько минут простоя аппарат автоматически выходит из этого режима.

⁵ Целевая температура определяется внутри аппарата.

Со стороны AIRFLOW® температура воды уменьшается по мере прохождения через шнур. Воздушный спрей также снижает температуру. Конечная температура аэрозоля AIRFLOW® является теплой, ниже 40 ° С.

Со стороны PIEZON® наконечник PIEZON® нагревает воду, что компенсирует её естественное охлаждение по мере прохождения через шнур. Измените настройку температуры для максимального комфорта пациента.

3.2. Цикл процедуры

! Обратитесь к Рекомендациям по проведению процедуры (документ серии FB-648) перед началом любых процедур для пациента.

AIRFLOW®

- 1 Разместите ёмкость для порошка.
- 2 Подайте давление в ёмкость.
- 3 Установите мощность AIRFLOW®.
- 4 Установите расход воды.
- 5 Возьмите наконечник AIRFLOW®
- 6 Нажмите на педаль для начала процедуры.
- 7 [Нажмите с усилием на центр педали ускорения для активации ускоренного режима BOOST.]
- 8 Отпустите педаль для остановки процедуры.
- 9 Поместите наконечник обратно в держатель.



PIEZON®

- 1 Установите мощность PIEZON®.
- 2 Установите расход воды.
- 3 Подсоедините ёмкость для воды PIEZON® (при необходимости).
- 4 Возьмите наконечник PIEZON®
- 5 Нажмите на педаль для начала процедуры.
- 6 [Нажмите с усилием на центр педали ускорения для активации ускоренного режима BOOST.]
- 7 Отпустите педаль для остановки процедуры.
- 8 Поместите наконечник обратно в держатель.



! Процедура не останавливается одномоментно. Помните, что существует небольшая задержка между отпуском педали и реальной остановкой процедуры (около 0,2 секунды).

! Риск травмирования пациента. Если вы не обучены проведению какой-либо процедуры, не выполняйте ее. Всегда проходите обучение перед выполнением новых процедур.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

4.1. Насадки PERIOFLOW®




Насадки только для одноразового применения.

⚠️ Она не может быть обработана и использована повторно.
Не используйте насадки с поврежденной или открытой упаковкой.

Подсоедините насадку до конца, нажав на твердую поверхность.

Убедитесь в том, что она правильно присоединена = полностью вставлена.




Снимите насадку с помощью экстрактора насадок.

⚠️ Риск получения травмы: Всегда ИСПОЛЬЗУЙТЕ экстрактор насадок AB-358/A. НЕ снимайте ее вручную.

4.2. Эндочак и PI-инструмент

Эндочаки доступны в вариантах на 90°, 120° или 180° для адаптации к конкретным ситуациям.

🚫 Не затягивайте гайку эндочака без установленного файла или инструмента, так как это может повредить его.

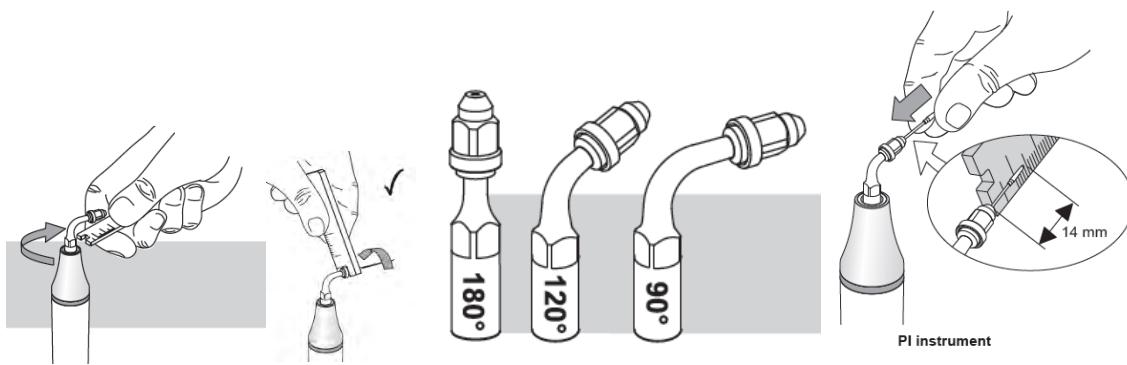

⚠️ Перед использованием убедитесь в том, что пластиковое покрытие не изношено и не повреждено.

4.3. Аспирационная трубка с зеркалом

Аспирационная трубка с зеркалом Ultra FS доступна только в Европейском союзе.



Аспирационная трубка с зеркалом Ultra FS ClasenUNO - это сочетание стоматологического зеркала и медицинской аспирационной трубы. Это устройство разработано для улучшения обзора обрабатываемой зоны и/или отсасывания жидкостей и частиц из ротовой полости пациента.

⚠ Трубка ClasenUNO должна обрабатываться перед использованием: чистка, дезинфекция и стерилизация.

⚠ Следуйте инструкциям по обработке ClasenUNO и нормам по обработке, действующим в вашей стране.

Подключите ее к высокоскоростному аспирационному шлангу вашей стоматологической установки и убедитесь в ее совместимости перед использованием (она может не соответствовать аспирационным шлангам вашей установки).

! Поверхность зеркала должна аккуратно высушиваться. Известковый налет на зеркале трудно, а иногда невозможно удалить.

Аспирационная трубка с зеркалом Ultra FS ClasenUNO разработана с учетом большого количества циклов стерилизации. Срок ее службы главным образом зависит от износа и повреждений при использовании.

! Всегда заменяйте это устройство при появлении признаков износа или повреждений.

5. ОЧИСТКА И ОБРАБОТКА

5.1. Очистка и дезинфекция водной линии

Поддержание чистоты и стерильности водных линий устройства необходимо для предотвращения занесения инфекции пациенту.

Раствор NIGHT CLEANER обеспечивает дезинфекцию и предупреждает формирование биопленки на водных линиях всех компонентов системы EMS AIRFLOW®, а также продлевает срок их службы при ежедневном использовании.

NIGHT CLEANER beseitigt und schützt wirksam vor Algen- und Kalkablagerungen nach längeren Standzeiten oder Erwärmung des Betriebswassers.

⚠ Шланг подачи воды и соответствующий соединительный элемент аппарата не промываются во время данной процедуры.



Каждое утро перед первым пациентом: Промывка



1 Поместите полностью наполненную ёмкость с водой в аппарат

⚠ Для снижения риска проглатывания чистящего средства пациентом всегда используйте полностью наполненную 800 мл ёмкость воды.




2 Установите воду на 10
Включите аппарат

⚠ Установите оба водных регулятора на 10 для обеспечения оптимального промывания.



3 Держите оба шнура над раковиной с помощью CLIP+CLEAN

Предотвращение загрязнения:
⚠ Избегайте какого-либо контакта между раковиной и шнурами.



4 Нажмите на педаль один раз, отпустите и затем подождите 1 минуту

На цифровой панели отображается обратный отсчёт бело-синими индикаторами.

Чистка может быть приостановлена и повторно запущена повторным нажатием педали.

⚠ Риск проглатывания чистящего средства. Убедитесь в том, что из шнура больше не вымываются синие осадки. В противном случае повторите процедуру.

! Всегда опустошайте и промывайте использованную ёмкость для воды для промывки перед любым новым использованием. EMS рекомендует еженедельно использовать средство для чистки бутылок (например, BC-San 100 от Alpro Medical GMBH).

⚠ Риск проглатывания остатков чистящего средства. Во время промывка небольшое количество чистящего средства попадает обратно в ёмкость для воды.

Между пациентами

Полная очистка и дезинфекция



Протрите внешнюю поверхность устройства мягкой тканью со спиртовым раствором

- ! Для чистки прибора следует применять только содержащие спирт (этанол, изопропанол) бесцветные дезинфицирующие средства.
- 🚫 Никогда не используйте чистящий порошок или жесткую губку. Это повредит поверхность.



⚠ Обработайте наконечники и инструменты
См. следующие специальные разделы.

⚠ Риск загрязнения. Всегда дезинфицируйте нижнюю и верхнюю зоны воздушных соединений устройства.

В конце дня: вечерняя чистка

⚠ В качестве чистящего средства используйте только EMS NIGHT CLEANER.

Другие средства могут повредить или не очистить аппарат, а также вызвать интоксикацию пациента.



Поместите ёмкость NIGHT CLEANER в аппарат

- ! Перед размещением удалите CLIP+CLEAN с устройства.

На каждую чистку необходимо 30 мл NIGHT CLEANER.

- ! Перед очисткой убедитесь в том, что уровень жидкости выше черной линии на горлышке бутылки.



**Установите воду на 10
Включите аппарат**

- ! Установите оба водных регулятора на 10 для обеспечения подачи чистящего средства.




Держите оба шнура над раковиной с помощью CLIP+CLEAN

Предотвращение загрязнения:

- ⚠ Избегайте какого-либо контакта между раковиной и шнурами.

- ⚠ CLIP+CLEAN должен подвергаться обработке после каждого использования.

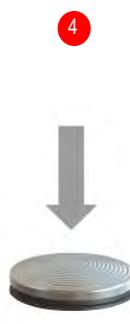

Нажмите на педаль один раз, отпустите и затем подождите 1 минуту

На цифровой панели отображается обратный отсчёт бело-синими индикаторами.

Чистка может быть приостановлена и повторно запущена повторным нажатием педали.

- ! После завершения оставьте ёмкость NIGHT CLEANER в устройстве на ночь (минимум 12 часов).

Средство NIGHT CLEANER может оставаться и действовать в водных линиях (на выходных, праздниках или на ночь) и требует контакта в течение не менее 12 часов для максимальной эффективности.



Наполняйте повторно ёмкость NIGHT CLEANER только средством NIGHT CLEANER

NIGHT CLEANER имеет следующие свойства:

- бактерицидное/фунгицидное действие;
- удаление и предотвращение образования известковых отложений и водорослей.
- Остается стабильным в ёмкости NIGHT CLEANER
- Синий цвет повышает осведомленность пользователя о процедуре чистки.

🚫 Не стерилизуйте ёмкость NIGHT CLEANER и её крышку-наконечник паром или сухой термообработкой. Используйте только активное дезинфицирующее средство или чистящее средство при температуре окружающей среды.

🚫 Не используйте растворы перекиси водорода, по типу средства EMS Ultra Clean. Она деактивируется через некоторое время в ёмкости аппарата.

5.2. Информация о безопасном использовании NIGHT CLEANER

🚫 НЕ смешивайте NIGHT CLEANER с другими чистящими растворами.

⚠️ NIGHT CLEANER нельзя глотать. Беречь от детей.
В случае проглатывания промойте рот водой. Не вызывайте рвоту.
При ощущении дискомфорта обратитесь к врачу.

⚠️ Не вдыхайте раствор NIGHT CLEANER. При попадании в дыхательные пути выйдите на свежий воздух и проконсультируйтесь с врачом в случае необходимости.

⚠️ Избегайте контакта с глазами. При попадании в глаза промойте их проточной водой в течение нескольких минут, держа веки открытыми. В случае ношения контактных линз снимите их при первой удобной возможности.

! Работайте с продуктом, надевая перчатки. При контакте с кожей смойте продукт водой с мылом.

При загрязнении одежды незамедлительно снимите ее. Если вы беспокоитесь о заражении, в кратчайшие сроки обратитесь к врачу.

! Для получения дополнительной информации обратитесь к инструкциям NIGHT CLEANER по использованию, прилагаемым к продукту.

Информация от производителя и контактные данные

Для получения дополнительной информации и/или направления жалоб вы также можете связаться с официальным производителем:

ALPRO MEDICAL GMBH

Mooswiesenstrasse 9

78112 St. Georgen, GERMANY

Phone: +49 7725 9392-0

www.alpro-medical.com

5.3. Обработка деталей EMS

EMS рекомендует использовать чистку, дезинфекцию и упаковку для стерилизации, а также стерилизационные процедуры согласно ISO 17664.

! Всегда сообщайте о негативных событиях, связанных с устройством, напрямую EMS.

! Многоразовые детали необходимо очищать, дезинфицировать и, если применимо, стерилизовать перед первым использованием. Не проводите обработку таких изделий сверх разрешенного количества циклов стерилизации. Вместо этого заменяйте их (см. часть о сроке службы в разделе "Техническое описание").

! Концентрации и время контакта, указанные изготовителем чистящего и дезинфицирующего вещества, следует соблюдать при любых условиях.

! Помните, что стерилизация может быть достигнута, только если элементы устройства очищаются и дезинфицируются первыми.



Если в следующих инструкциях что-то является неясным или кажется несоответствующим действительности, свяжитесь, пожалуйста, с компанией EMS.

! Следующие инструкции утверждены для применения при подготовке к повторному использованию медицинских устройств и элементов EMS, перечисленных в разделе "Назначение устройства и Совместимость". Пользователь должен обеспечить достижение необходимого результата обработки используя имеющееся оборудование, материалы и персонал. Это требует утверждения процесса обработки и его регулярного контроля. Соответственно, любое отклонение оператора от предоставленных инструкций должно быть внимательно изучено на предмет эффективности и возможных нежелательных последствий.

Пользователь также должен соблюдать все применимые законодательные нормы своей страны, а также нормы гигиены больницы или клиники. Это положение особенно актуально для дополнительных требований по деактивации прионов.

Подготовка


Необходимо провести предварительную ручную чистку

Сразу же после использования промойте полость центрального просвета (ов) сердцевины наконечника / насадки водой в течение 20 секунд. Грубое загрязнение необходимо удалить сразу после нанесения.

! Для AIRFLOW® и PERIOFLOW®: всегда удаляйте закупорку наконечника порошком и проверяйте очистку обеих полостей (водной и порошковой) перед продолжением.


! Для PIEZON®:

- Снимите установленный инструмент.
- Снимите колпачок и отложите световод и прокладку.

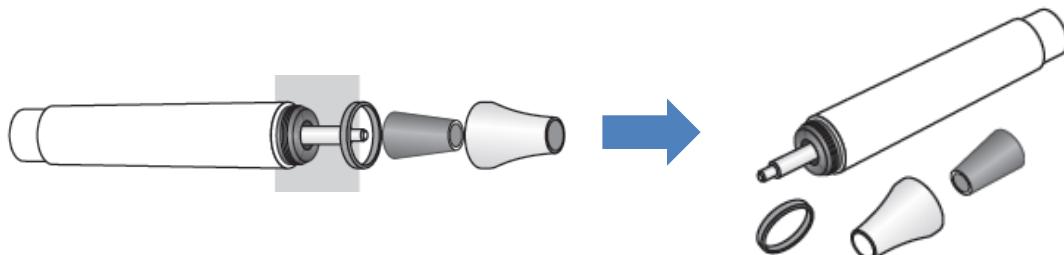


! Для эндочака:

- Удалите установленный инструмент/файл.
- Снимите винт и малое уплотнительное кольцо (прокладку).

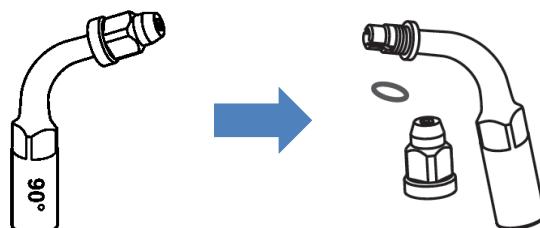

! Для любого инструмента, установленного на CombiTorque:

- разделите его и CombiTorque.

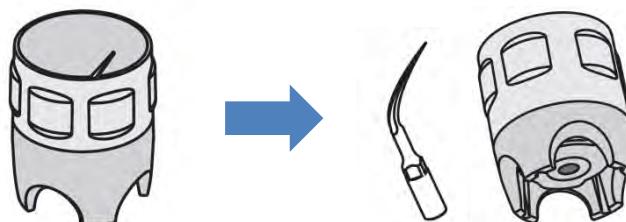

Аккуратно отнесите в зону обработки, чтобы избежать любого повреждения деталей и загрязнения среды и людей, вовлеченных в процесс обработки.

! Чистка должна быть проведена в течение 1 часа после использования.

Чистка

Любая деталь может быть очищена вручную или автоматически мойкой или дезинфектором. EMS рекомендует использовать автоматическую мойку-дезинфектор (МД), соответствующую ISO 15883, для оптимизации эффективности и продления срока службы детали.

 **НЕ используйте очистку в ультразвуковых ваннах с наконечниками PIEZON®, AIRFLOW® и PERIOFLOW® — это может привести к повреждению данных изделий.**

Ручная чистка (без ультразвуковой ванны)

Следующая утвержденная процедура может применяться с любым элементом EMS:

- Удалите любое загрязнение поверхности (крупные загрязнения) на изделии смоченным куском ткани и водопроводной водой.
- Очистите устройства в чистящем растворе 0,5% Neodisher MediClean (Dr. Weigert Hamburg) дейонизированной водой при 40°C щеткой с подходящей мягкой щетиной (Medisafe MED100.33) до удаления видимых осадков.
- Если детали имеют полости, промойте их спрей-пистолетом (струей под статическим давлением 2 бар) холодной водопроводной водой в течение 15 секунд.
- Погрузите деталь в 0,5% раствор Neodisher MediClean с дейонизированной водой на 15 минут при 40°C. Все полости должны быть наполнены чистящим раствором (при необходимости используйте шприц). Все поверхности должны быть смочены.
- Промойте все полости спрей-пистолетом (струей под статическим давлением 2 бар) холодной дейонизированной водой в течение 15 секунд, а затем ополосните всю деталь под холодной проточной дейонизированной водой в течение 10 секунд.
- С помощью пневмопистолета (сжатый воздух) полностью просушите полости и всю деталь до удаления всех остатков воды (видимых или осязаемых).

Автоматическая чистка

 Омыватель-дезинфектор должен соответствовать стандарту ISO 15883, должен иметь подходящие корзины для хранения мелких хрупких продуктов и должен иметь ополаскивающие соединения диаметром примерно 16 мм для крепления к просвету продукта.

Правильно положите инструмент на подходящую подставку, соедините все полости с промывочными коннекторами и начните автоматическую чистку. Может использоваться следующий утвержденный автоматический процесс чистки (Например на Miele Professional G 7836 CD с Miele Rack E429):


- 2-минутная предварительная промывка холодной водой.
- Слив воды.
- 5 мин. чистка водопроводной водой с 0,5% моющим средством Neodisher MediClean (Dr. Weigert, Hamburg) при 55°C.
- Слив воды.
- 3 мин. ополаскивание и нейтрализация холодной дейонизированной водой.
- Слив воды.
- Окончательное 2 мин. ополаскивание холодной дейонизированной водой.
- Слив воды.

 Также необходимо следовать указаниям производителя мойки-дезинфектора.

Ручная чистка с ультразвуковой ванной**~~НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ С НАКОНЕЧНИКОМ~~**

Следующая утвержденная процедура применима только для инструментов и держателей буров/инструментов EMS PIEZON:

- Удалите любое загрязнение поверхности (крупные загрязнения) на изделии смоченным куском ткани и водопроводной водой.
- Если детали имеют полости, промойте их спрей-пистолетом (струей под статическим давлением 2 бар) холодной водопроводной водой в течение 15 секунд.
- С помощью соответствующего сита для очистки ультразвуком погрузите деталь в 0,5% раствор Neodisher MediClean с деионизированной водой и воздействуйте на нее ультразвуком в течение 10 минут при 40°C (Bandelin, Sonorex 1028K, 35 кГц). Все полости должны быть наполнены чистящим раствором (при необходимости используйте шприц). Все поверхности должны быть смочены.
- Промойте все полости спрей-пистолетом (струей под статическим давлением 2 бар) холодной деионизированной водой в течение 15 секунд, а затем ополосните всю деталь под холодной проточной деионизированной водой в течение 10 секунд.
- С помощью пневмопистолета (сжатый воздух) полностью просушите полости и всю деталь до удаления всех остатков воды (видимых или осязаемых).

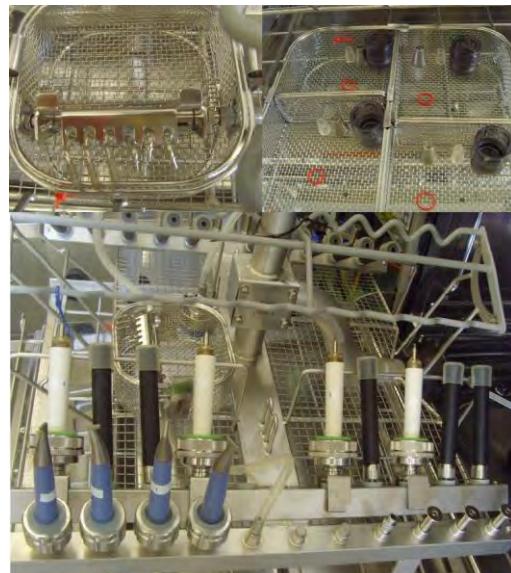

Пример правильного расположения деталей
в МД Miele Professional G 7836 CD
с помощью мобильного блок-инжектора (подставка) Miele E429

Дезинфекция

Любая деталь может быть продезинфицирована вручную или автоматически дезинфектором.

НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ!

Автоматическая дезинфекция

! EMS рекомендует использовать автоматическую мойку-дезинфектор (МД), соответствующую ISO 15883, для оптимизации эффективности и продления срока службы детали.


Все детали EMS могут проходить автоматическую термическую дезинфекцию в мойке-дезинфекторе согласно норме ISO 15883.

Следующий утвержденный (Например на Miele Professional G 7836 CD с Miele Rack E429) процесс может использоваться для достижения уровня A₀ в 3000:

- Выполнение 3-минутной термической дезинфекции (финальная промывка) деионизированной водой при мин. 93°C.
- Слив воды.
- Сушка не менее 20 минут при 100°C.

! Также необходимо следовать конкретным указаниям и предупреждениям производителя мойки-дезинфектора.

⚠ При использовании химических дезинфицирующих веществ внимательно следуйте инструкциям производителя дезинфицирующего раствора.

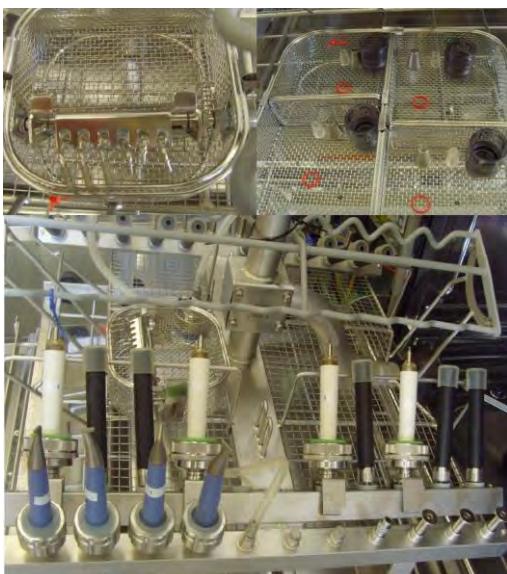

Пример правильного расположения деталей
в МД Miele Professional G 7836 CD
с помощью мобильного блок-инжектора (подставка) Miele E429

АЛЬТЕРНАТИВА

Ручная дезинфекция

🚫 Не используйте дезинфекцию в ультразвуковых ваннах с насадками PIEZON®, AIRFLOW® и PERIOFLOW® — это может привести к повреждению данных изделий.

- Дезинфицирующий раствор ASP CIDEX OPA® 0,55% должен использоваться нерастворенным в рамках срока годности, в соответствии с предостережениями производителя и в точном соответствии с его инструкциями по эксплуатации.
- Дезинфицирующий элемент должен быть налит в подходящий контейнер с надежной крышкой. Размер контейнера должен позволять полностью погрузить в него устройство и легко удалять воздух изнутри.
- Нагрейте дезинфицирующий элемент до минимум 20°C.
- Полностью погрузите изделие и, если применимо, наполните все полости и удалите воздушные карманы с помощью шприца, наполненного дезинфицирующим элементом (для обеспечения полного внутреннего контакта с ним).
- Закройте контейнер его крышкой.
- Подождите не менее 5 минут и убедитесь в том, что температура дезинфицирующего раствора не падает ниже 20°C.
- Дезинфицирующий элемент ASP CIDEX OPA требует 3 (трех) промываний значительным объемом свежей воды для надлежащего удаления его остатков. Стерильная вода должна наливаться в надлежащие контейнеры для промыва. Размер контейнера должен позволять полностью погрузить в него устройство и легко удалять воздух изнутри.

Для каждого из 3 промываний:

- обильно промойте струей воды все полости (не менее 100 мл). Для правильного выполнения этой задачи используйте шприц или водный распылитель.
- Держите устройство полностью погруженным в течение не менее чем 1 минуты.
- Выньте устройство из промывочного контейнера и выпейте воду.
- И, наконец, полностью высушите его внутри и снаружи.

⚠ Всегда используйте свежую воду для каждого промывания. Не используйте воду повторно для промывания и для других целей. Остатки дезинфицирующего элемента могут вызывать серьезные побочные эффекты.

⚠️ Окончательные требования к промывке водой:

Не содержит факультативных патогенных микроорганизмов. Рекомендована деионизированная вода во избежание образования осадков или кристаллизации на медицинском устройстве. Следует учитывать потенциальное бактериальное загрязнение в зависимости от используемого процесса очистки воды.

⚠️ Стерилизация должна проводиться сразу же после чистки-дезинфекции.

Осмотр и окончательная сушка перед стерилизацией

⚠️ Если после чистки/дезинфекции на детали все еще видны пятна, всю процедуру чистки/дезинфекции следует повторить. Детали с видимыми повреждениями, сколами, трещинами, следами коррозии или погнувшиеся изделия следует утилизировать (дальнейшее использование запрещено). Также проверьте уплотнительные кольца и прокладки и замените их, если они повреждены или потеряли форму.

! Убедитесь в том, что деталь полностью сухая. При обнаружении остатков воды удалите их с помощью пневмопистолета (чистый сжатый воздух). Полностью просушите полости и всю деталь до удаления всех остатков воды (видимых или осязаемых).

Повторная сборка и упаковка для стерилизации


⚠️ Только предварительно очищенные и дезинфицированные детали могут быть стерилизованы.

⚠️ Эффективная стерилизация может проводиться только с полностью сухими деталями. Убедитесь в том, что каждая деталь (внутренние полости и все поверхности) полностью сухая перед сборкой и упаковкой.

Перед стерилизацией детали необходимо собрать до готовности к использованию и поместить в подходящую стерилизационную упаковку.


! Для PIEZON®:

- Сначала установите прокладку, затем вставьте световод в носовой колпачок и завинтите его на наконечнике.

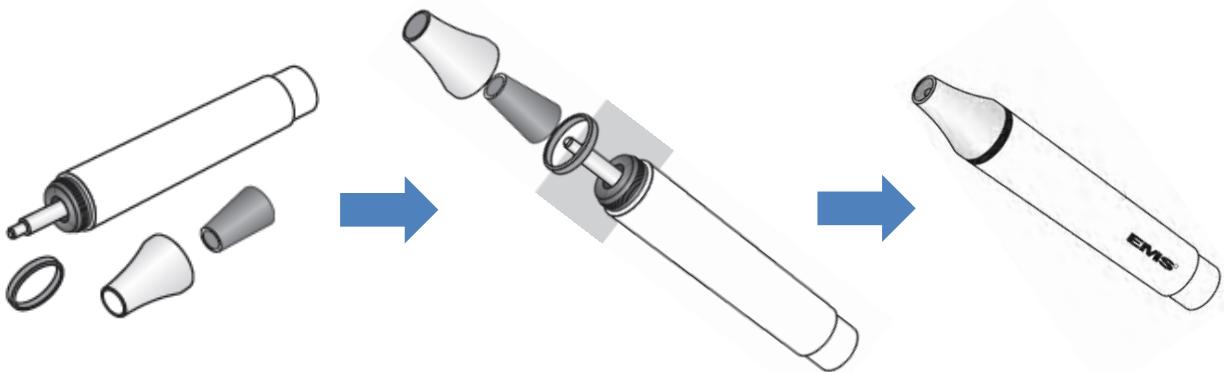


! Для держателя эндочак-бурава:

- Сначала установите на место малое уплотнительное кольцо (прокладку), затем осторожно завинтите удерживающий болт, не затягивая его.

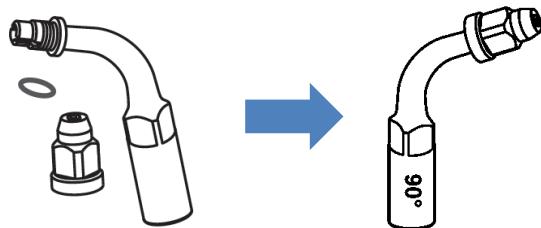

! Для любого инструмента с CombiTorque:

- Установите инструмент в CombiTorque.

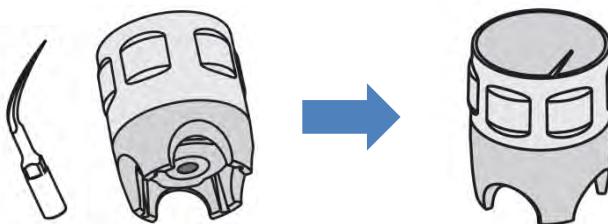

Любая деталь EMS может правильно упакована с помощью следующей утвержденной процедуры:

- Одиночные или двойные пакетики, подходящие для стерилизации влажным жаром и соответствующие ISO 11607-1 (или EN 868), устойчивые к температуре 138°C, с соответствующим уровнем паропроницаемости (плоские ролики Wipak STERIKING, тип R43 и R44).

Стерилизация

⚠ Стерилизация должна проводиться сразу же после чистки-дезинфекции.

🚫 НЕ превышайте максимальное разрешенное число стерилизационных циклов.

🚫 НЕ превышайте температуру стерилизации 138°C и время выдержки 20 минут.

🚫 НЕ используйте стерилизацию горячим воздухом и радио-стерилизацию — они уничтожают данные изделия.

Стерилизация деталей влажным жаром должна выполняться согласно ISO 17665 и с соблюдением соответствующих местных требований.

С любой деталью EMS, упакованной в соответствующие одиночные или двойные пакетики, может использоваться следующий процесс фортвакуумной стерилизации влажным жаром (паром):

Параметры для форвакуумного цикла стерилизации влажным жаром:

- 3 форвакуумных фазы
- Температура стерилизации: 132°C
- Давление 3 бар (абсолютное давление)
- Влажность: 100%
- Время выдержки: минимум 3 минуты (полный цикл)
- Время сушки: минимум 20 минут

 Пользователь должен обеспечить условия достижения процессами обработки, включая ресурсы, материалы и персонал, необходимых результатов, сохраняющихся со временем: пользователь должен поддерживать актуальность утверждения процессов обработки.

Хранение

 Хранение стерилизованных инструментов в сухой, чистой и защищенной от пыли среде при температуре от 5°C до 40°C.

Срок службы

 Если количество циклов стерилизации ограничено, это будет указано в инструкциях по эксплуатации к таким изделиям (если имеются) и/или в главе "Срок службы" раздела "Техническое описание".

Данная продукция рассчитана на многократное повторение циклов стерилизации. Материалы, использованные при ее производстве, подобраны соответственно. Однако каждая новая подготовка к использованию, термическое и химическое воздействие вызывают старение данных изделий.

 Всегда заменяйте изделия с признаками износа или преждевременного ухудшения вне зависимости от оставшегося количества неиспользованных циклов стерилизации.

 НЕ подвергайте данную продукцию воздействию температур более 138°C.

5.4. Обработка трубы ClasenUNO

 Следующие инструкции приведены в документации Cleverdent "Инструкции для ClasenUNO", издание 03/2016, и актуальны на дату выпуска. Мы рекомендуем вам регулярно посещать сайт Cleverdent или связываться с ними напрямую для получения последней версии их инструкции по эксплуатации и обработке.

 Аспирационная трубка с зеркалом Ultra FS ClasenUNO требует обработки в соответствии со стандартом EN ISO 17664. Регулярно проверяйте трубку перед использованием и заменяйте ее при появлении признаков износа.

Чистка и дезинфекция

Только дезинфицирующие растворы, подходящие для полипропилена (ПП) и используемые в соответствии с инструкциями, могут применяться для чистки и дезинфекции. Во избежание риска царапанья зеркала и трубы не используйте жесткие (проволочные) щетки при очистке. Требования стандарта EN ISO 17664 должны соблюдаться. Сначала уберите видимую грязь, затем промойте ClasenUNO под проточной водой. Для ClasenUNO с зеркалом Ultra для промывки используйте дистиллированную воду. Поместите загрязненную ClasenUNO в подходящий дезинфицирующий раствор. Следуйте рекомендациям производителя раствора относительно уровней концентрации дезинфицирующего раствора и длительности дезинфекции. Тщательно промойте ее водой после дезинфекции и хорошо высушите. Затем продезинфицируйте/простерилизуйте с помощью одного из указанных ниже методов.

Ультразвуковая дезинфекция

Убедитесь в том, что поверхность зеркала полностью сухая, особенно при версии Ultra, так как в противном случае известковый налёт может запекаться. Поместите ClasenUNO в ультразвуковую ванну (напр., Bandelin Sonorex Super RK 514). Добавьте чистящее и дезинфицирующее средство, подходящее для полипропилена (ПП) (например, 0,55% Cidex OPA) и установите цикл мойки в соответствии с инструкциями производителя. Держите ее в ультразвуковой ванне 12 минут и следите за тем, чтобы температура не падала ниже 18°C. Затем промойте стерильной водой до полного удаления остатков чистящего средства. Убедитесь в том, что ClasenUNO тщательно очищена и при необходимости повторите цикл чистки. И наконец, тщательно высушите ClasenUNO.

Дезинфекция с термическим дезинфектором

Для чистки и дезинфекции термическим дезинфектором используйте устройство, соответствующее EN ISO 15883 (напр., Belimed WD 100) и соблюдайте инструкции производителя при выборе цикла чистки и дезинфекции и чистящего средства. Поместите ClasenUNO в термический дезинфектор так, чтобы внутренние поверхности промывались, а вода могла вытекать. 0,5% (V/V) deconex 24 LIQ зарекомендовал себя как подходящий чистящий раствор, а 0,2% (V/V) deconex 26 Plus - как нейтрализационный. Дезинфекция проходит при 90°C в течение 5 минут. В конце цикла чистки и дезинфекции убедитесь в том, что ClasenUNO тщательно очищена и при необходимости повторите цикл чистки.

Стерилизация

Стерилизация паром должна выполняться с использованием устройства, соответствующего EN 13060 или EN 285 (напр., автоклав с применением фракционной форвакумной процедуры, W&H, тип LISA 517), с соблюдением правил стерилизации стандарта EN ISO 17665-1. Цикл должен проходить со стерилизационной температурой 134°C в течение 5 минут или стерилизационной температурой 121°C в течение 12 минут.

Информация от производителя и контактные данные

Для получения дополнительной информации и/или направления жалоб вы также можете связаться с официальным производителем:

Cleverdent Ltd.,

Theresiengrund 31, DE - 48149 Münster, Германия.


Тел.: +49 (0) 251 98292828

Сайт: www.clasen.uno - Email: info@clasen.uno

6. ОБСЛУЖИВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

6.1. Закупорка наконечника AIRFLOW® порошком

! При закупорке наконечника и перед обработкой наконечников AIRFLOW® и PERIOFLOW®.

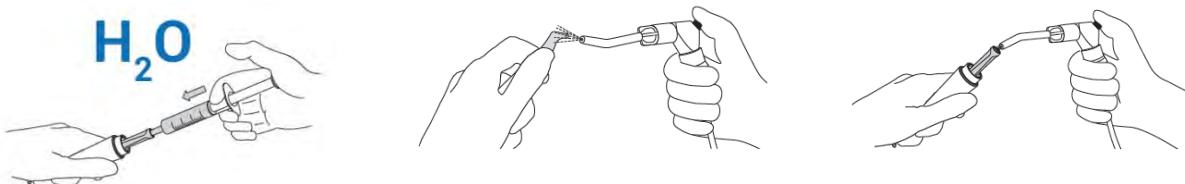


! Промойте через центральный просвет в обычном направлении потока (обратное промывание запрещено), используя Easy Clean с помощью съемного шприца, наполненного более чем 2 мл питьевой воды

Продуйте воздухом для высушивания.

Инструмент Easy Clean может быть термически дезинфицирован, а также простерилизован при температуре до 135°C в автоклаве.

6.2. Течь в наконечнике AIRFLOW®

При появлении течи в месте соединения наконечника AIRFLOW® со шнуром AIRFLOW® замените уплотнительные кольца шнура на запасные из набора EL-651, входящего в комплект AIRFLOW®.

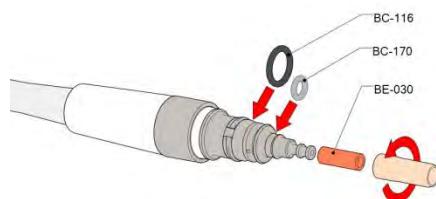

6.3. Световод PIEZON®: проверка и замена

Световод утрачивает свою прозрачность после многократной обработки. Проверяйте его прозрачность ежемесячно и выполняйте следующие действия:



1. Снимайте кончик и отвинчивайте колпачок наконечника вручную.
2. Снимите световод и осмотрите его.
3. Установите новый световод AB-340 (прилагается к PIEZON®).
4. Завинтите колпачок снова, только вручную.

6.4. Замена шнура наконечника

 Выньте шнур питания от электросети для проведения техобслуживания или при неисправности.

 Снимите давление в ёмкости для порошка перед отключением шнура AIRFLOW®.

При сохраняющейся неисправности или повреждении системы шнура наконечника PIEZON® или AIRFLOW® этот элемент может быть легко заменен пользователем. Следуйте инструкциям по замене, прилагающимся к запчастям.



Процедура отсоединения шнура наконечника:

1. Разблокируйте систему шнура, толкнув блокиратор вперед (находится под устройством).
2. Теперь система разблокирована, ее можно удалить, потянув за нее.



6.5. Ежемесячные проверки

Каждый месяц проверяйте чистоту воздушного и водного фильтров.

 Выньте шнур питания от электросети для проведения техобслуживания или при неисправности.

 Обслуживание не может выполняться, когда аппарат применяется на пациенте.



 Проверьте чистоту водного и воздушного фильтра.

Цвет фильтра должен быть белым, без значительных видимых загрязнений. Если это не так, замените его. Если водный фильтр приходится менять более 3 раз в год, проверяйте качество вашей водной линии. Воздушные фильтры остаются чистыми более длительный период времени. Заменяйте их один раз в год. (ежегодное техобслуживание включает в себя замену обоих фильтров).



Хорошо

1.  Сначала отключите шнур питания от сети.
2. Отсоедините водный шланг, потянув его из разъема.
3. Вытаскивайте фильтр руками или с помощью небольшой плоской отвертки.
4. Замените на новый фильтр и подключите шланг снова.



Износ

6.6. Ежегодное обслуживание и ремонт



⚠️ Устройство должно обслуживаться и/или ремонтироваться только компанией EMS и сертифицированными ремонтными центрами EMS.

1



⚠️ Ежегодное профилактическое обслуживание или обслуживание после 2000 часов работы (Светодиод 1 ПОСТОЯННО горит оранжевым), по более раннему событию, необходимо для поддержания безопасной и эффективной работы в интересах как пациента, так и пользователя.

Квалифицированный сервисный ремонт также может стать необходимым при любой сохраняющейся неисправности, обнаруженной пользователем и/или при проведении диагностики устройства.



При возврате устройства в целях обслуживания мы рекомендуем поместить устройство вместе с педалью, ёмкостью для порошка, ёмкостью для воды и шнурами в их оригинальную упаковку для оптимизации защиты от повреждений при транспортировке.

Предоставьте контактные данные вашего дилера EMS для ускорения процесса обслуживания (См. § 6.9).

6.7. Подключение новой педали



1. Выньте одну батарейку из педали (нет необходимости вынимать обе).
2. Поместите оба наконечника в их держатели.
3. Выключите установку, подождите 10 секунд и включите ее снова.
4. Нажмите сначала ① + ⑤, затем также одновременно нажмите ⑩.
Начнет воспроизводиться звуковой сигнал (если нет, повторите шаг 4).
Соблюдайте порядок и трехпальцевую последовательность (см. рисунок ниже: поместите пальцы в паз под цифрами).
5. Во время звучания сигнала замените литиевые батарейки в беспроводной педали.
6. Через короткое время (менее 15 секунд) подключение будет завершено, вы увидите мигание белого светодиода, и аппарат будет готов к использованию.



Если процесс занимает более 1 минуты, это означает, что подключение не выполнено, и устройство автоматически выйдет из этого режима (при выходе не будет звучать звуковой сигнал и мигать лампочка).

В этом случае повторите процедуру сначала.

6.8. Поиск и устранение неполадок



Устройство издает свист или странные звуки

Риск взрыва ёмкости для воды.

Сначала выньте шнур питания от электросети.

или трещины в ёмкости для воды.

- 1) Незамедлительно прекратите использование аппарата и отключите его от сети.
- 2) Проверьте используемую ёмкость на наличие трещин или повреждений и при их наличии замените ее.
- 3) Проверьте давление подаваемого воздуха: оно должно составлять не менее 4,5 бар.
- 4) Если температура аппарата ниже 10°C (аппарат слишком холодный), дождитесь его нагрева до температуры окружающей среды, подключите его к сети и снова включите.
- 5) Если температура аппарата выше 10°C или если проблема сохраняется, полностью прекратите его использование и свяжитесь со службой послепродажного обслуживания EMS.



Дым (и огонь)

Риск возгорания и поражения электротоком.

Сначала выньте шнур питания от электросети.

Незамедлительно прекратите использование вашего аппарата, отключите его от сети и свяжитесь со службой послепродажного обслуживания EMS.



1

Течь в шнуре или аппарате

Риск возгорания и поражения электротоком.

Сначала выньте шнур питания от электросети.

- 1) Если течь замечена в наконечнике AIRFLOW®, замените уплотнительные кольца.
- 2) Если течь в аппарате (держатель наконечника и водный регулятор), замените весь шнур наконечника.
- 3) Если проблема по-прежнему не решена, свяжитесь со службой послепродажного обслуживания EMS.

Светодиод 1 ПОСТОЯННО горит оранжевым

Автоматическое напоминание о техническом обслуживании. Пришло время отправить ваше аппарат на ежегодное техническое обслуживание.

Срочно свяжитесь со службой послепродажного обслуживания EMS.

Светодиод 1 МИГАЕТ оранжевым

Обнаружены постоянные или временные сбои.

- 1) Выньте шнур питания аппарата из сети, подождите 30 секунд, затем вставьте его обратно и перезапустите аппарат (для проверки постоянства состояния сбоя).
- 2) Если ошибка сохраняется, свяжитесь со службой послепродажного обслуживания EMS для проведения ремонта.



2

Светодиод 2 ПОСТОЯННО горит оранжевым

Заряд 2-х литиевых батареек AA беспроводной педали на исходе. Замените их обе на новые высококачественные литиевые батарейки AA с защитой в виде токоограничителя.



3

Светодиод 3 ПОСТОЯННО горит оранжевым

Проблема может иметь множество причин. Необходимо провести множество пошаговых проверок.

- 1) Педаль не обнаружена (для работы с аппаратом необходимо подключить как минимум одну педаль):
 - Педаль с проводным подключением может быть отключена. Убедитесь в том, что штекель полностью вставлен. Перезапустите устройство.
 - Беспроводная педаль не подключена. Выполните процедуру "Подключение новой педали".
- 2) Если ошибка сохраняется, свяжитесь со службой послепродажного обслуживания EMS для проведения ремонта.

Светодиод 3 МИГАЕТ оранжевым

Обе системы шнуров AIRFLOW® и PIEZON® не обнаружены или потеряны. Для работы с устройством необходима как минимум одна система шнура.

- 1) Сначала выключите аппарат, затем отсоедините шнуры обеих наконечников AIRFLOW® и PIEZON® и очистите электрические контакты (штекеры) на соединениях системы шнура. Также продуйте воздухом, чтобы очистить приемники соединений.
- 2) Установите на место оба шнура наконечников и снова запустите аппарат.
- 3) Если ошибка сохраняется, свяжитесь со службой послепродажного обслуживания EMS.

4**Светодиод 4 МИГАЕТ оранжевым**

Риск возгорания и поражения электротоком.



Сначала выньте шнур питания из электросети.

1) Ваш аппарат перегрет. Выньте его шнур питания из розетки, подождите 1 час и запустите аппарат снова.

2) Если ошибка сохраняется, свяжитесь со службой послепродажного обслуживания EMS.

Примечание: эта ошибка также появляется, когда аппарат работает при температуре ниже минимальной.

В этом случае просто дождитесь нагрева аппарата до температуры окружающей среды.

**Течь водного фильтра**

Сначала выньте шнур питания из электросети.

1) Замените водный фильтр (синий картридж).

2) Если проблема по-прежнему не решена, свяжитесь со службой послепродажного обслуживания EMS.

**Течь в ёмкости для воды или её соединении**

1) Убедитесь в том, что крышка ёмкости правильно закрыта.

2) Очистите соединение (со стороны крышки и аппарата).

3) Замените ёмкость для воды.

4) Если проблема по-прежнему не решена, свяжитесь со службой послепродажного обслуживания EMS.

**Течь в соединении AIRFLOW®**

1) Убедитесь в том, что наконечник правильно подсоединен к шнуру.

2) Очистите внутреннюю часть наконечника и конец шнура.

3) Замените прокладку шнура AIRFLOW®, как указано в параграфе "Течь в наконечнике AIRFLOW®".

4) Если проблема по-прежнему не решена, свяжитесь со службой послепродажного обслуживания EMS.

**Недостаточно или нет воды из наконечника**

1) Убедитесь в том, что водные регуляторы установлены на 10 (максимальный расход в шнуре), и что в наконечнике нет засорения, сняв его и проверив расход воды без наконечника.

2) Проверьте чистоту фильтра и замените его при необходимости.



Выньте шнур питания от электросети перед работой с любым фильтром.

3) Убедитесь в правильном соединении и достаточном давлении со стороны источника подачи воды.

4) Если проблема по-прежнему не решена, свяжитесь со службой послепродажного обслуживания EMS.

**Некоторое количество синей жидкости остается после промывки**

1) Убедитесь в том, что установили водные регуляторы на 10 (максимальный расход в шнуре).

2) Убедитесь в правильном соединении и достаточном давлении со стороны источника подачи воды.

3) Проведите вторую фазу промывки перед лечебной процедурой.

4) Если проблема по-прежнему не решена, свяжитесь со службой послепродажного обслуживания EMS.

**Аппарат не запускается**

1) Проверьте электрическое подключение и электрическую розетку.

2) Проверьте предохранители на тыльной стороне аппарата:



Сначала выньте шнур питания от электросети.

Предохранители размещены в разъеме для провода питания.

1) Отключите провод питания от аппарата.

2) С помощью небольшой плоской отвертки откройте крышку гнезда предохранителей.

3) Замените предохранители только на аналоги именно того типа, который необходим (см. раздел "Техническое описание").

4) Если проблема по-прежнему не решена, свяжитесь со службой послепродажного обслуживания EMS.

**Беспроводная педаль не работает**

Если ясно, что педаль была нажата более 10 мин., просто отпустите ее и выключите, а затем включите аппарат. В ином случае у этой проблемы может быть множество причин. Необходимо провести многократные пошаговые проверки:

1) Выключите аппарат и отсоедините, а затем снова присоедините обе системы шнура PIEZON® и AIRFLOW®. Попробуйте еще раз.

2) Выполните новое подключение к аппарату. Эта процедура описана в параграфе "Подключение новой педали". Попробуйте еще раз.

3) Замените 2 литиевые батареи AA и попробуйте еще раз.

4) Если проблема по-прежнему не решена, свяжитесь со службой послепродажного обслуживания EMS.



Педаль с проводным подключением не работает

- 1) Отключите и снова подключите педаль. Проверьте кабель на отсутствие повреждений. Перезапустите аппарат.
- 2) Если проблема по-прежнему не решена, свяжитесь со службой послепродажного обслуживания EMS.

Нет давления в ёмкости для порошка

- 1) Проверьте, что ваш аппарат включен: как минимум 1 светодиод должен быть включен.
- 2) Проверьте, что система шнура AIRFLOW® правильно подключена (горит зеленый маркер на приводе замка).
- 3) Если проблема по-прежнему не решена, свяжитесь со службой послепродажного обслуживания EMS.

Белый индикатор ёмкости для порошка МИГАЕТ при попытке создания давления

- Либо не подключена воздушная линия, либо нет достаточного давления.
- 1) Убедитесь в отсутствии перегибов на воздушной линии и проверьте работу воздушного компрессора.
 - 2) Проверьте чистоту фильтра и замените его при загрязнении.
 - 3) Если проблема по-прежнему не решена, свяжитесь со службой послепродажного обслуживания EMS.

Белый индикатор ёмкости для порошка МИГАЕТ при снятии давления

- 1) Наконечник может быть засорен. Устранит засор с помощью Easy Clean (см. параграф ниже).
- 2) Шнур AIRFLOW® может быть засорен. Демонтируйте и очистите конец шнура AIRFLOW.
- 3) Если проблема по-прежнему не решена, свяжитесь со службой послепродажного обслуживания EMS.



Порошок разлетается из ёмкости при снятии давления

- 1) Ёмкость для порошка наполнена сверх отмеченного максимального уровня.
- 2) Удалите порошок, превышающий отметку уровня "MAX" на ёмкости.



Утечки порошка под держателем наконечника AIRFLOW®

- Элемент крепления AIRFLOW® может быть изношен, или воздушное соединение загрязнено и выпускает порошок.
- 1) Отсоедините шнур, прочистите воздушный штекер и подсоедините снова. Если проблема сохраняется, переходите к Шагу 2.
 - 2) Замените ваш шнур наконечника AIRFLOW® на новый.
 - 3) Если проблема по-прежнему не решена, свяжитесь со службой послепродажного обслуживания EMS.



Ёмкость для порошка имеет течь

- 1) Очистите ёмкость влажным куском ткани, особенно крышку и нижние уплотнительные кольца. Также очистите соединительные элементы прибора.
- 2) Если проблема не решена, замените ёмкость для порошка на новую.



Белый СВЕТОДИОД PIEZON® не работает

- 1) Очистите и высушите соединение наконечника и попробуйте еще раз.
- 2) Светодиод наконечника PIEZON® мог выключиться в режиме пауз:
 - через 10 минут после непрерывной работы;
 - через 20 секунд без работы вне держателя.
- В обоих случаях вставьте наконечник обратно в держатель, подождите 1 минуту и попробуйте еще раз.
- 3) Если проблема по-прежнему не решена, свяжитесь со службой послепродажного обслуживания EMS.

Недостаточное освещение

- 1) Проверьте световод и при необходимости замените.
- 2) Если свет по-прежнему слабый, замените наконечник.



Поврежденный световод

Замените световод.



Механическая мощность от PIEZON® мала или отсутствует, либо ощущаются вибрации

- 1) Убедитесь в том, что инструмент PIEZON® (кончик) правильно привинчен (используйте ключ CombiTorque).
- 2) Проверьте инструмент (кончик) на предмет износа и при необходимости замените его.
- 3) Очистите и высушите электрические соединения наконечника и системы шнура.
- 4) Сначала замените наконечник PIEZON®.
- 5) Замените шнур наконечника PIEZON®.
- 6) Если проблема по-прежнему не решена, свяжитесь со службой послепродажного обслуживания EMS.

6.9. Координаты для связи со службой поддержки EMS

E.M.S. Electro Medical Systems S.A.

Ch. de la Vuarpilli re 31

1260 Nyon – Switzerland

Телефон: +41 (0) 22 99 44 700

Факс: +41 (0) 22 99 44 701

Email: TSAV@ems-ch.com

6.10. Для сообщения о неблагоприятном событии необходимо

При возникновении любого серьезного инцидента, прямо или косвенно связанного с процедурой, незамедлительно сообщите о нем EMS и компетентному органу в вашей стране и в стране размещения пациента (если различаются).

Сообщение о неблагоприятном событии EMS

По электронной почте: vigilancemailbox@ems-ch.com

По факсу: +41 (0) 22 99 44 701

По почте: E.M.S. Electro Medical Systems S.A., Ch. de la Vuarpilli re 31, 1260 Nyon – Switzerland

7. ЭКОЛОГИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

7.1. Утилизация использованных частей



Данное изделие запрещено утилизировать с бытовыми отходами. Если вы хотите отправить устройство на окончательную утилизацию, то необходимо соблюдать при этом действующие в стране соответствующие специальные нормы.

Иные части данного устройства, включая кончики/вставки, и химические вещества должны быть утилизированы в соответствии с нормами вашей страны.

Утилизируемое электрическое и электронное оборудование, владельцы которого находятся на территории Европейского союза, может быть отправлено в EMS для вторичной переработки в соответствии с требованиями директивы WEEE. Расходы на такую переработку, за исключением транспортных затрат, покрываются компанией EMS.



Сохраняйте оригинальную упаковку устройства до окончательной его утилизации. Упаковку можно использовать для пересылки или хранения изделия.

7.2. Экологичная конструкция



При производстве данного аппарата на добровольной основе соблюдаются нормы потребления, касающиеся эко-конструкции с низким расходом энергии в режиме ожидания и при выключении⁶. Упаковочный картон выполнен из переработанных материалов и может быть переработан в дальнейшем.



Печатные инструкции согласованы с политикой устойчивого развития и сертифицированы «Myclimate neutral imprimerie» и «FSC».

8. ГАРАНТИЯ

Гарантия не действует, если устройство использовалось с не оригиналными порошком, инструментами и наконечниками EMS. Гарантия не действует, если аппарат вскрывался.

Компания EMS и дистрибутор не несут ответственности за прямой или косвенный ущерб, который может возникнуть в результате неправильной эксплуатации аппарата, в частности, из-за несоблюдения инструкции по эксплуатации, а также неправильной подготовки или неправильного технического обслуживания.

Компания EMS не несет ответственность за безопасность аппарата и объявляет гарантию недействительной в случае выполнения обслуживания или ремонта неуполномоченными третьими сторонами или применения неоригинальных запасных частей.

⁶ Норма Европейской комиссии №1275/2008 от 17 декабря 2008 г. относительно требований к эко-конструкции, касающихся режима ожидания и выключеного состояния при использовании бытовых электроприборов

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Изготовитель	EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS SA, CH-1260 Nyon, Швейцария
Модели	AIRFLOW Prophylaxis Master, код изделия FT-229
Классификация IEC 60601-1	Электрическая изоляция класса I Рабочая часть типа В Блок управления IP20 Ножная педаль IP21
Классификация EU MDD 93/42/EEC	Медицинское устройство класса IIa
Основная характеристика	Данное медицинское устройство, в значении EU MDD 93/42, не имеет основной характеристики
Рабочий режим	Непрерывная работа
Блок питания	100-240 VAC, 50-60 Гц, 4 А макс.
Потребляемая мощность	ВЫКЛ-режим / Режим ожидания: 0,5 Вт макс. Макс.: 700 ВА
Ультразвуковой модуль	Максимальная выходная мощность 8 Вт в состоянии полной механической нагрузки. Частота: 24-32 кГц Амплитуда первичной вибрации кончика: макс. 200 мкм
Предохранитель	5 А, T (медленный), 250 В пер.т., Н-тип (=T5H250V)
Беспроводной модуль связи	Радиомодуль макс. 1 дБм ЭИИМ, диапазон 2,4 ГГц, Bluetooth®
Вес	Блок управления 5 кг макс. (полностью рабочее состояние) Ножная педаль: 0,35 кг макс. (беспроводная педаль)
Размеры	Блок управления: Высота: 245 мм, Ширина: 260 мм, Длина: 290 мм Беспроводная педаль: диаметр 135 мм, высота 35 мм
Условия эксплуатации	Температура: от 10°C до 35°C Влажность: 30% - 75% Высота над у/м: макс. 2000 м
Условия хранения	Температура: от -10°C до 30°C, без воды внутри Влажность: 10% - 95% без конденсата Давление: 500 гПа до 1060 гПа
Условия транспортировки	Температура: от -29°C до 38°C, без воды внутри Влажность: 10 % - 95% без конденсата Давление: 500 гПа до 1060 гПа
Водные жидкости	Вода: давление 2-5 бар, температура 10-30°C, минерализация макс. 0,2%, твердость от 8 до 12 ° dH , мин. расход 100 мл/мин, тип разъема RECTUS 20KA. Необходима водопроводная сеть/ввод, соответствующие стандарту EN-1717. Воздух: давление 4,5-7 бар, только сухой (влажность макс. 1,032 г/куб.м.), фильтр. масло макс. 0,1 мг/куб.м., мин. расход 20 Нл/мин при 4,5 бар, тип разъема RECTUS 21KA
Потоки на выходе	Вода: минимальный 40 мл/мин. для AIRFLOW®, минимальный 30 мл/мин. для PIEZON® Воздух: макс. давление 5 бар для AIRFLOW®
Срок годности / срок годности	Ёмкости PIEZON® и NIGHT CLEANER: 5 года Наконечники (основные корпуса): 1000 стерилизационных циклов CombiTorque: 1000 стерилизационных циклов
Ожидаемый срок службы	Устройство: 7 лет, с регулярным ежегодным профилактическим обслуживанием

9.1. Символы



Общее предупреждение
Предупреждение об электричестве
Неионизирующее излучение (радиосвязь)
Прочтите инструкции по эксплуатации
Устройство, требующее защитного заземления
Выньте шнур питания от электросети для проведения техобслуживания или при неисправности
Электронные инструкции по применению
Обязательное действие
Срок годности
Для однократного использования. Повторное использование запрещено.
Не делать этого.
Защита от проникновения воды
Рабочая часть типа В
Утилизация старого электронного оборудования (применяется в Европейском союзе и других европейских странах, в которых имеются системы раздельного сбора отходов)
Изготовитель
Дата производства
Серийный номер
Номер по каталогу / код изделия
Стерилизовать в автоклаве при температуре до 135°C
Термическая дезинфекция
Вход
Выход
Предохранитель
Соединение ножной педали с проводным подключением
RCM - маркировка Австралии (электрическая безопасность, ЭМС, ЭМВ и телекоммуникационные требования)
Маркировка изделий, являющихся радиопередающими в Новой Зеландии
Медицинское устройство, соответствующее Директиве ЕС 93/42/EEC
Номер нотифицированного органа
Маркировка соответствия техническим нормам - Украина UA – обозначение Украины;
TR – временный символ Учреждения по оценке соответствия, назначаемого для проведения оценки соответствия требованиям технических норм;
028 – идентификационный номер назначенного Учреждения по оценке соответствия.
Южноафриканский знак ICASA для радиооборудования
TA-2017-2826: номер официального утверждения типа радиооборудования
Корейский знак KC Mark для вещательного и коммуникационного оборудования
R-RMM-E23-FT-229: регистрационный номер системы
KCC-CRM-BGT-BLE113: регистрационный номер модуля Bluetooth

9.2. Электромагнитная совместимость

Использование деталей, отличных от тех, которые поставляются или указаны как вспомогательные элементы, может негативно отразиться на ЭМС.

Устройство использует маломощный радиомодуль, макс. 1 дБм ЭИИМ, Bluetooth 2,4 ГГц для связи с беспроводной педалью. Этот радиомодуль отключается при подключении педали с проводным соединением (необходим перезапуск устройства).

Bluetooth-модуль соответствует всем ограничениям, предусмотренным рекомендациями ERC 70-03 для стран СЕРТ в отношении Приложения 3 (диапазон Широкополосной передачи цифровых данных А 2400-2483,5 МГц), не требуя каких-либо изменений данных изделий пользователем.

Аппарат предназначен для использования, и основная безопасность обеспечивается в описанной ниже электромагнитной среде. Потребитель или оператор аппарата должен убедиться, что он используется в такой среде.

Соответствие защите от электромагнитных полей

Испытание на устойчивость	IEC 60601 испытательный уровень	Уровень соответствия	Электромагнитная среда – руководство
Снятие электростатического разряда (ESD) IEC 61000-4-2		± 8 кВ контакт ± 15 кВ воздух	Пол должен быть деревянным, бетонным или кафельным. Если пол покрыт синтетическим материалом, относительная влажность должна составлять > 30%.
Быстрые электрические переходные процессы/всплески IEC 61000-4-4	± 2 кВ для линий электроснабжения, частота повторения 100 кГц		Качество электропитания должно соответствовать электропитанию стандартного коммерческого или медицинского помещения.
Перенапряжение IEC 61000-4-5	± 1 кВ для входных/выходных линий, частота повторения 100 кГц	± 1 кВ от линии (линий) к линии (линиям)	Качество электропитания должно соответствовать электропитанию стандартного коммерческого или медицинского помещения.
Провалы напряжения IEC 61000-4-11	± 2 кВ от линии (линий) к земле	± 2 кВ от линии (линий) к земле	
Прерывания напряжения IEC 61000-4-11	<5 % UT (>95 % провал в UT) для 0,5 цикла 40 % UT (60 % провал в UT) для 5 циклов 70 % UT (30 % провал в UT) для 25 циклов 0 % UT для 0,5 цикла при 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° и 315° 0 % UT для одной фазы 1 цикла	<5 % UT (>95 % провал в UT) для 5 с 0 % UT для 250 циклов	Качество электропитания должно соответствовать электропитанию стандартного коммерческого или медицинского помещения. Если оператору устройства необходимо, чтобы устройство работало в течение длительного времени во время перерывов в электроснабжении, рекомендуется подключить устройство к источнику бесперебойного питания или батареи.
Магнитное поле с частотой питающей сети (50/60 Гц) IEC 61000-4-8	30 А/м	30 А/м (50 Гц или 60 Гц)	Магнитное поле с частотой питающей сети должно находиться на уровне, характерном для стандартного коммерческого или медицинского помещения.
Наведенные радиоволны IEC 61000-4-6	3 В от 150 КГц до 80 МГц 6 В в пределах промышленного, научного и медицинского диапазонов и диапазона любительских радиостанций от 150 КГц до 80 МГц 80 % АМ при 1 КГц	3 В	Портативное и мобильное оборудование для радиочастотной связи должно использоваться с пространственным разносом между ним и устройством, включая кабели, не менее рекомендованного, рассчитанного на основании уравнения, применяемого к частоте излучателя. Рекомендованный пространственный разнос $d = 1,17 \sqrt{P}$, $d = 1,17$ от \sqrt{P} 80 МГц до 800 МГц, $d = 2,4 \sqrt{P}$ от 800 МГц до 2,7 ГГц где P - максимальная выходная мощность излучателя в ваттах (Вт) в зависимости от производителя излучателя, а d - рекомендуемый пространственный разнос в метрах (м). Уровень сигнала стационарных радиочастотных излучателей, как определено в электромагнитных исследованиях ⁷ помещения, должен быть меньше уровня соответствия требованиям в каждом частотном диапазоне ⁸ . Вблизи оборудования, отмеченного символом, могут возникнуть помехи:
Излучаемые радиоволны IEC 61000-4-3		3 В/м	
Поля приближения от РЧ-оборудования беспроводной связи IEC 61000-4-3	3 В/м от 80 МГц до 2,7 ГГц 80% АМ при 1 КГц		
	См. таблицу ниже		

Примечания:

- UT - напряжение сети пер.т. перед применением испытательного уровня.
- При частоте 80 МГц и 800 МГц применяется высший частотный диапазон.
- Это руководство не может применяться ко всем ситуациям. На распространение электромагнитных волн влияет поглощение и отражение от конструкций, предметов, людей.

⁷ Уровень сигнала стационарных излучателей, таких как базовая радиостанция для сотовых/беспроводных телефонов, любительская радиостанция, АМ- и FM-радиовещание и телевизионное вещание, невозможно точно предсказать. Для оценки электромагнитной среды от стационарных радиоизлучателей необходимо провести специальное электромагнитное исследование помещения. Если измеренный уровень излучения в помещении, в котором используется устройство, превышает указанный выше применимый уровень соответствия требованиям по радиочастотам, необходимо проверить правильность функционирования устройства. В случае неправильного функционирования необходимо предпринять дополнительные меры, такие как разворот или перестановка устройства.

⁸ За пределами диапазона 150 КГц - 80 МГц уровень излучения должен быть менее 3 В/м.

Поля приближения от РЧ-оборудования беспроводной связи
IEC 61000-4-3

Тестовая частота (МГц)	Диапазон (МГц)	Сервис	Модуляция	Максимальная мощность (Вт)	Расстояние (м)	Уровень теста на устойчивость (В/м)
385	380-390	TETRA 400	Импульсная модуляция 18 Гц FM	1,8	0,3	27
450	430-470	GMRS 460, FRS 460	отклонение ±5 КГц 1 КГц синусоидальн.	2	0,3	28
710						
745	704-787	LTE-диапазон 13, 17	Импульсная модуляция 217 Гц	0,2	0,3	9
780						
810		GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, LTE-диапазон 5	Импульсная модуляция 18 Гц	2	0,3	28
870	800-960	GSM 1800, CDMA 1900, GSM 1900, DECT, LTE-диапазон 1, 3, 4, 25, UMTS	Импульсная модуляция 217 Гц	2	0,3	28
930						
1720						
1845	1700-1990					
1970						
2450	2400-2570	Bluetooth, WLAN, 802.11g/n, RFID 2450, LTE-диапазон 7	Импульсная модуляция 217 Гц	2	0,3	28
5240						
5500	5100 – 5800	WLAN 802.11a/n	Импульсная модуляция 217 Гц	0,2	0,3	9
5785						

Рекомендованный пространственный разнос

Устройство может использоваться в электромагнитной среде с контролируемыми излучаемыми радиоволнами. Потребитель или оператор устройства в состоянии предотвратить электромагнитные помехи, соблюдая минимальное расстояние между портативным и мобильным оборудованием для радиосвязи (излучатели) и устройством в соответствии с максимальной выходной мощностью средств связи.

Максимальная выходная мощность излучателя, Вт	Пространственный разнос в зависимости от частоты излучателя (м)		
	от 150 КГц до 80 МГц $d = \frac{3,5}{V} \sqrt{P}$ c V=3 В	от 80 МГц до 800 МГц $d = \frac{3,5}{E} \sqrt{P}$ c E=3 В/м	от 800 МГц до 2,5 ГГц $d = \frac{7}{E} \sqrt{P}$ c E=3 В/м
0,01	0,12	0,12	0,24
0,1	0,37	0,37	0,74
1	1,17	1,17	2,34
10	3,69	3,69	7,4
100	11,67	11,67	23,4

Для излучателей с максимальной выходной мощностью, не указанной в перечне, рекомендуемый пространственный разнос d в метрах (м) может быть рассчитан на основании уравнения, применимого к частоте излучателя, где P - максимальная выходная мощность излучателя в ваттах (Вт) в зависимости от производителя излучателя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данное оборудование было испытано и признано соответствующим ограничениям для цифрового устройства класса B в соответствии с частью 15 Правил Американской государственной комиссии по коммуникациям. Данные ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредоносных помех в бытовом использовании. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и при установке и использовании вопреки требованиям инструкции может создавать вредоносные помехи для радиосвязи. Однако нет гарантии, что помехи не возникнут при установке в отдельном здании. Если данное оборудование создает вредоносные помехи для приема радио- или телесигнала, что может быть определено включением-выключением этого оборудования, пользователь может попытаться скорректировать такие помехи одним или несколькими из следующих способов:

- перенацелить приемную антенну или изменить ее местоположение;
- увеличить расстояние между данным оборудованием и приемником;
- подключить это оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник;
- проконсультироваться с дилером или опытным радио/ТВ-техником для получения помощи.

Соответствие по электромагнитным излучениям

Проверка излучения	Соответствие	Электромагнитная среда – руководство
Радиоизлучение по стандарту CISPR 11	Группа 1	Устройство использует радиочастотную энергию исключительно для внутренних функций. При этом его радиоизлучение очень низко и не создает помех находящемуся поблизости электронному оборудованию.
Радиоизлучение по стандарту CISPR 11	Класс В	
Эмиссия гармонических составляющих IEC 61000-3-2	Класс А	Устройство может использоваться в любых помещениях включая жилые и напрямую подключенные к коммунальной электросети низкого напряжения, питающей предназначенные для проживания здания.
Колебания напряжения / фликкер-излучения IEC 61000-3-3	Соответствует	

9.3. Соответствие радиооборудования

Данное медицинское устройство и все его вспомогательные элементы с радиооборудованием соответствуют Европейской директиве 2014/53/EU (RED – Директива о радиооборудовании).

EMS	TFD-245 ред. 2017.06.14																		
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПО РАДИООБОРУДОВАНИЮ 2014/53/EU																			
<i>Мы,</i>																			
Название производителя:	E.M.S. Electro Medical Systems S.A.																		
Адрес:	Ch. de la Vuarpillière 31, CH-1260 Nyon, Швейцария,																		
заявляем под нашу единоличную ответственность, что следующая продукция																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Название изделия</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Код изделия</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Тип встроенного радиомодуля</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Начиная с серийного номера</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">AIRFLOW Prophylaxis Master®</td> <td style="padding: 5px;">FT-229</td> <td style="padding: 5px;">Bluetooth V4.0, диапазон 2,4 ГГц</td> <td style="padding: 5px;">KU00001</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">AIRFLOW® One</td> <td style="padding: 5px;">FT-230</td> <td style="padding: 5px;">Bluetooth V4.0, диапазон 2,4 ГГц</td> <td style="padding: 5px;">LD00010</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Беспроводная педаль ускорения</td> <td style="padding: 5px;">EK-404</td> <td style="padding: 5px;">Bluetooth V4.0, диапазон 2,4 ГГц</td> <td style="padding: 5px;">KZ00051</td> </tr> </tbody> </table>				Название изделия	Код изделия	Тип встроенного радиомодуля	Начиная с серийного номера	AIRFLOW Prophylaxis Master®	FT-229	Bluetooth V4.0, диапазон 2,4 ГГц	KU00001	AIRFLOW® One	FT-230	Bluetooth V4.0, диапазон 2,4 ГГц	LD00010	Беспроводная педаль ускорения	EK-404	Bluetooth V4.0, диапазон 2,4 ГГц	KZ00051
Название изделия	Код изделия	Тип встроенного радиомодуля	Начиная с серийного номера																
AIRFLOW Prophylaxis Master®	FT-229	Bluetooth V4.0, диапазон 2,4 ГГц	KU00001																
AIRFLOW® One	FT-230	Bluetooth V4.0, диапазон 2,4 ГГц	LD00010																
Беспроводная педаль ускорения	EK-404	Bluetooth V4.0, диапазон 2,4 ГГц	KZ00051																
к которой относится данная декларация, соответствует основным и другим применимым требованиям Директивы по радиооборудованию 2014/53/EU, прежде всего и помимо прочего, следующим стандартам и/или нормативным документам:																			
БЕЗОПАСНОСТЬ <ul style="list-style-type: none"> • IEC 60601-1:2005 + A1:2012 • EN 62311: 2008 																			
ЭМС <ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 301 489-1 в. 2.1.1 (2016-11) • ETSI EN 301 489-17 в. 3.1.1 (2016-11) 																			
ДИАПАЗОН <ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 300 328 в. 2.1.1 (2016) 																			
Дополнительная информация Нотифицированный орган LCIE (Laboratoire Central des Industries Electriques), идентификационный номер 0081, выполнил оценку соответствия указанных выше изделий посредством типового исследования для ЕС, за которым последовало установление соответствия типа на основе внутреннего производственного контроля. В результате он выдал сертификат об исследовании ЕС-типа: № 147779-701316-A.																			
Полная версия документа о техническом состоянии хранится у E.M.S. Electro Medical Systems S.A.																			
Дата и место выдачи: Ньон, 2017-06-14																			
Уполномоченный представитель: _____ Тимоти Деблок, руководитель отдела контроля качества																			
P. 1/1																			
E.M.S. Electro Medical Systems S.A. Ch. De la Vuarpillière 31, CH-1260 Nyon, ШВЕЙЦАРИЯ. Тел.: (022) 99 44 700. Факс: (022) 99 44 701																			

10. АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

A

AIRFLOW, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 36, 37, 40, 41, 44

B

BLUETOOTH, 9, 12, 44, 46, 47

C

CLASENUO, 8, 23, 35

CLEVERDENT, 35

CLIP+CLEAN, 7, 14, 24, 25

COMBITORQUE, 16

COMBITORQUE, 16

E

E.M.S. ELECTRO MEDICAL SYSTEMS S.A., 42, 50

N

NIGHT CLEANER, 7, 10, 24, 25, 26

P

PERIOFLOW, 8, 13

PERIOFLOW, 3, 6, 8, 15, 22, 36

PIEZON, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 36, 37, 40, 41

РІ-ІНСТРУМЕНТ, 22

A

АКУСТИЧЕСКАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ, 20
АСПИРАЦИОННАЯ ТРУБКА, 23, 35

Б

БАТАРЕЙКИ, 7, 12, 38, 39, 40

БЕСПРОВОДНАЯ ПЕДАЛЬ, 6, 9, 12, 17, 38, 39, 44, 46

БУТЬЛЬ NIGHT CLEANER, 44

БУТЬЛЬ PIEZON, 44

В

В КОНЦЕ ДНЯ, 25

ВЕЧЕРНЯЯ ЧИСТКА, 25

ВКЛ/ВЫКЛ, 17

ВОДА, 7, 9, 10, 14, 17, 21, 24, 25, 26, 35, 36, 37, 40, 44, 45

ВОДНАЯ, 4, 9, 10, 11, 24, 35, 39, 40

ВОЗДУХ, 3, 7, 9, 10, 17, 33, 36, 37, 41, 46

ВОЗДУШНАЯ, 4, 9, 10, 11, 41

ВЫНТЕ ШНУР ПИТАНИЯ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ, 2, 37, 45

Д

ДЕЗИНФЕКЦИЯ, 7, 25, 26, 27, 32, 35

ДЕЗИНФЕКЦИЯ, 35

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ РАСТВОРЫ, 14

Е

ЕЖЕГОДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, 38
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, 37

З

ЗАГРЯЗНЕНИЕ, 9, 10, 25
ЗАКРЕПИТЕ УСТРОЙСТВО, 11
ЗАМЕНА ШНУРА, 37
ЗАСОРЕНIE, 15
ЗАСОРЕННАЯ НАСАДКА, 36
ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ, 2, 9, 12

И

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, 2, 4
ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, 2
ИНСТРУМЕНТЫ, 5, 16, 25, 43
ИНТЕРФЕЙСЫ, 17
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, 26, 35
ИНЦИДЕНТ, 2

К

КАЖДОЕ УТРО, 24
КАМЕРЫ ДЛЯ ПОРОШКА, 7, 13
КАТЕГОРИЯ ПАЦИЕНТОВ, 4
КЛИНИЧЕСКИЙ РИСК, 13
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, 26, 35
КОНЧИК, 16, 18, 19

М

МЕЖДУ ПАЦИЕНТАМИ, 25
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, 6

Н

НАСТРОЙКА МОЩНОСТИ, 17
НЕИСПРАВНОСТЬ, 2, 6, 37

О

ОБРАБОТКА, 15, 16, 23, 27, 35
ОБУЧЕНИЕ, 4
ОСНОВНОЙ ВИНТ, 7, 11

П

ПЕДАЛЬ, 17
ПОДКЛЮЧЕНИЕ НОВОЙ ПЕДАЛИ, 38
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК, 12, 15, 39
ПОЛНАЯ ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ, 25
ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ДАВЛЕНИЕ, 17, 41
ПОРОШОК, 5, 13, 17, 21, 25, 36, 37, 38, 41, 43
ПОРОШОК CLASSIC, 13
ПОРОШОК PLUS, 13
ПОСТАВЛЯЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, 7

ПРИМЕНЕНИЕ, 3, 36

ПРОВЕРЬТЕ, 7, 9

ПРОВЕРЬТЕ ДЛИНУ КОНЧИКА, 16

ПРОМЫВКА, 24

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 5

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ, 38, 44

Р

РАБОЧИЕ ЧАСТИ, 6

РЕМОНТ, 38, 39, 43

РИСК ВОЗГОРАНИЯ, 12, 39, 40

РИСК НАНЕСЕНИЯ ВРЕДА ПАЦИЕНТУ, 21

РИСК ПЕРЕЛОМА КОНЧИКА, 18, 19

РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, 2

РИСК ПРОГЛАТЫВАНИЯ, 24

С

С ЗЕРКАЛОМ, 23, 35

СВЕТОВОД, 16, 36, 41

СВЯЗЬСЯ СО СЛУЖБОЙ ПОДДЕРЖКИ EMS, 42

СИМВОЛЫ, 45

СНЯТИЕ ДАВЛЕНИЯ, 17, 41

СОВМЕСТИМОСТЬ, 5

СТЕРИЛИЗАЦИЯ, 23, 27, 32, 33, 34

СТЕРИЛИЗАЦИЯ, 34

Т

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ, 20

У

УДАЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ В ОТХОДЫ, 43

УСКОРЕННЫЙ РЕЖИМ, 17, 19

Ц

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ, 4

Ч

ЧИСТКА, 3, 24, 25, 35

ЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДНОЙ ЛИНИИ, 24

Ш

ШНУРЫ, 11, 17, 24, 25, 38, 39

Э

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ, 46, 48

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОМЕХИ, 6

ЭНДО, 18, 19

ЭНДОЧАК, 5, 8, 22



ШТАБ-КВАРТИРА



НЬОН, ШВЕЙЦАРИЯ

E.M.S. ELECTRO MEDICAL SYSTEMS S.A.

Ch. de la Vuarpillière 31

CH-1260 Nyon

Тел.: +41 22 99 44 700

Факс: +41 22 99 44 701

www.ems-dental.com/en/contact

www.ems-dental.com



ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ ФИЛИАЛОВ EMS

МЮНХЕН, ГЕРМАНИЯ

EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS GMBH

Schatzbogen, 86

D-81829 Munich

Тел.: +49 89 42 71 61 0

Факс: +49 89 42 71 61 60

info@ems-ch.de



МАДРИД, ИСПАНИЯ

EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS ESPAÑA SLU

c/ Tomás Bretón, 50-52, 2^a planta

E-28045 Madrid

Тел.: +34 91 528 99 89

info@ems-espana.com



ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS FRANCE SARL

32, Route de Pontarlier

F-39460 Fonscine-le-Haut

Тел.: +33 3 84 51 90 01

Факс: +33 3 84 51 94 00

info@ems-france.fr



МИЛАН, ИТАЛИЯ

EMS ITALIA S.R.L.

Via Faravelli, 5

I-20149 Milan

Тел.: +39 02 3453 8111

Факс: +39 02 3453 2778

dental@ems-italia.it



ДАЛЛАС, США

EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS Corporation

11886 Greenville Avenue, #120

Dallas, TX 75243

Тел.: +1 972 690 83 82

Факс: +1 972 690 89 81

info@ems-na.com



ШАНХАЙ, КИТАЙ

医迈斯电子医疗系统贸易（上海）有限公司

E.M.S. ELECTRO MEDICAL SYSTEMS

TRADING (SHANGHAI) CO., LTD.

24A, No 379, Jin Sui Mansion

Pudong Nan Road

Shanghai 200120

Тел.: +862133632323

emschina@ems-ch.com